



PULS OXIMETER / PULSOXIMETER / OXYÈTRE DE POULS SPO 3 A1

(GB) (IE) (NI) (MT)

PULS OXIMETER

Operating instructions

(NL) (BE)

PULSOXIMETER

Gebruiksaanwijzing

(PT)

PULSOXÍMETRO

Manual de instruções

(DE) (AT) (BE) (CH)

PULSOXIMETER

Bedienungsanleitung

(IT) (CH) (MT)

PULSOSSIMETRO

Istruzioni per l'uso

(FR) (BE) (CH)

OXYÈTRE DE POULS

Mode d'emploi


(ES)

PULSIOXÍMETRO



Instrucciones de uso

IAN 518645_2504


(DE) (AT) (CH) (FR) (ES)
(IT) (PT) (BE) (NL)




English	Operating instructions	Page	1
Deutsch	Bedienungsanleitung	Seite	47
Français	Mode d'emploi	Page	95
Nederlands	Gebruiksaanwijzing	Pagina	151
Italiano	Istruzioni per l'uso	Pagina	199
Español	Instrucciones de uso	Página	247
Português	Manual de instruções	Página	293

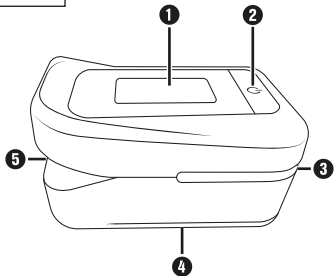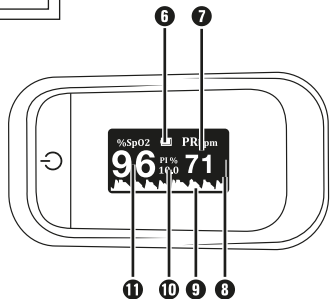A**B**

C



D

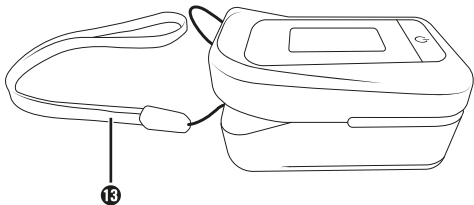

Contents

1. Introduction	3
2. Intended use	3
2.1. Contraindications	4
3. Package contents	5
4. Warnings and symbols used	5
5. Safety information	13
5.1. Safety instructions for handling batteries	20
6. Device description	24
7. Getting started	26
7.1. Inserting/replacing the batteries.	26
7.2. Attaching the carry strap.	27

7.3. Taking a reading	27
7.4. Evaluating the readings	28
7.5. Adjusting settings	30
8. Cleaning	32
9. Storage	32
10. Disposal	33
10.1. Disposal of batteries	34
11. Technical specifications	35
12. Kompernass Handels GmbH warranty	41
12.1. Service	45
12.2. Importer	46

1. Introduction

Congratulations on the purchase of your new device.

You have selected a high-quality product. The instructions for use are part of this product. They contain important information about safety, usage and disposal. Before using the product, please familiarise yourself with all instructions regarding safety and use. Use the product only as described and for the specified applications. Keep these operating instructions as a reference and store them near the product. Please also pass on all documents to any future owner.

2. Intended use

This device is intended for non-invasive measurement of arterial haemoglobin oxygen saturation and pulse rate on the finger of an adult. Oxygen saturation is an important indicator for the evaluation of respiratory function.

Low oxygen saturation can indicate a condition such as asthma or cardiac insufficiency. If this is the case, consult a doctor immediately!

The device is not intended for use on newborns and small children or on persons with severe cardiac arrhythmias.

The device is suitable for self-monitoring. No special expertise is required; patients can operate the device themselves.

This device is intended solely for use in private households. Not for commercial or industrial use.

2.1. Contraindications

During pregnancy, we recommend consulting a doctor before use. Preeclampsia patients may not use the device.

The device is not suitable for patients with implanted devices such as pacemakers or defibrillators. Do not use the device if you have metallic implants.

3. Package contents

The following components are included in delivery:

- Pulse oximeter
- 2 x alkaline batteries AAA (LR03)
- Carry strap
- Instructions for use

4. Warnings and symbols used

The following warnings and symbols are used in these instructions for use, on the packaging and on the device (where applicable):



DANGER! A warning with this symbol and the signal word "DANGER" indicates an imminently hazardous situation which will result in death or serious injury if not avoided.

	WARNING! A warning with this symbol and the signal word "WARNING" indicates a potentially hazardous situation which could result in death or serious injury if not avoided.
	CAUTION! A warning with this symbol and the signal word "CAUTION" indicates a potentially hazardous situation that could result in a minor or moderate injury if not avoided.
	ATTENTION! A warning with this symbol and the signal word "ATTENTION" indicates a potential situation that could result in property damage if not avoided.
	Note: A note identifies additional information that facilitates the use of the device.

	Follow the instructions! Read the instructions before beginning to use or operate devices or machines.
	DC current/voltage
	Medical product
	Importer
	Type BF: The device has been designed to protect the patient from electric shock.
IP22	Protected against foreign bodies ≥ 12.5 mm and against water ingress at an angle

%SpO₂	Arterial oxygen saturation of haemoglobin (in percent)
PR bpm	Pulse rate (beats per minute)
PI %	The perfusion index (PI) is the ratio of pulsatile to non-pulsatile blood flow in the patient's peripheral tissue.
	Battery charge indicator
	Year/month of manufacturing
	Unique device identifier: Code for unique product identification
	Serial number
	Item number

	Type number
	Temperature range
	Humidity range
	Air pressure range
	Do not dispose of electrical devices in the household waste!

	Dispose of the packaging in an environmentally-responsible manner.
	Good until
	The packaging is made of recyclable materials. Observe the labelling on the packaging material when sorting for disposal: The material is labelled with abbreviations (a) and numbers (b) with the following meanings: 1 -7: plastics, 20-22: paper and cardboard, 80-98: composites.



The packaging contains paper and/or cardboard components.



The packaging contains plastic and/or metal components.

ES/PT



This product satisfies the requirements of the applicable European and national regulations.



This mark confirms that the product complies with the product safety requirements applicable in the UK.



Manufacturer's address: Shenzhen BSX Technology Electronics Co., Ltd.
Rm101,2/F~4/F, Building no.13, Ailian Industrial Park, Wulian Community, Longgang District, Shenzhen 518116 Guangdong, P.R. China



Authorized party in the European Community / European Union:
MedNet EC-REP GmbH, Borkstraße 10, 48163 Münster, Germany



FR

Cet appareil,
ses accessoires
et piles
se recyclent

À DÉPOSER
EN MAGASIN



ou

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



FR



+



FR



FR: The product, packaging and operating instructions are recyclable. They are subject to extended producer responsibility and are collected separately.

5. Safety information

WARNING!

- This device is not intended for use by persons (including children) with limited physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and/or knowledge unless they are supervised by a person who is responsible for their safety, or receive instructions from this person on how to use the device.
- Children must be supervised to make sure that they do not play with the device.

- Do not use the device if you have electrical implants (e.g. pacemaker).
- Do not use the device if you have metallic implants.
- Do not use the device on newborns, children and pets.
- Do not use the device if you are allergic to rubber products.
- Do not use the device if the device or the finger is wet.
- Do not use the device during a blood pressure measurement on the arm wearing the cuff.
- Do not use the device on fingers with nail polish, dirt or bandages.

- Do not use the device on fingers that are very thick and cannot be inserted easily into the device. The same applies to fingers that are too small.
- Do not use the device on fingers with anatomical alterations, oedemas, scars, nail polish, artificial nails, other cosmetics or burns.
- Do not use the device on patients if the application site is not at rest (e.g. trembling).
- Do not use the device for longer than about 2 hours on one finger.

- Do not look inside the device during operation. The light could cause eye damage.
- Do not use the device near strong light sources.
- The readings you take yourself serve only for self-monitoring – they are not a replacement for a medical examination! Discuss your values with your doctor. Never use them as the basis for your own medical decisions (medications and or dosing)!
- Cardiovascular disease can lead to incorrect readings or reduced accuracy of the readings.

This also applies in the case of very low blood pressure, diabetes, circulatory disorders and cardiac arrhythmias as well as shivering or tremors.

- The displayed readings are not suitable for reliable pulse diagnosis, they only reflect the current optical signal variation at the measurement site.
- Do not carry out any self-diagnosis or treatment on the basis of the readings without consulting your doctor. In particular, do not independently change the type and/or dosage of an existing medication and do not add any medications on your own.

- The device can only indicate a momentary reading and cannot be used for continuous monitoring.

ⓘ **ATTENTION!**

- Only use accessories that are included in the scope of delivery or recommended by the manufacturer.
- Protect the device from moisture, dust, high temperatures and direct sunlight.

- If the device has been stored at a temperature near the limit values for the storage and transport temperature and then brought into an environment at 20 °C, wait about 2 hours for the device to reach room temperature before using it.
- Do not open the device housing or attempt to disassemble or repair the device yourself. This is unsafe and invalidates the warranty.
- Do not allow the device to fall and do not subject it to any strong vibrations.

- Because the device contains sensitive electronic components, avoid using it in the vicinity of a strong electromagnetic field (mobile telephone, microwave oven, etc.) since this could lead to inaccurate results.

5.1. Safety instructions for handling batteries

⚠ WARNING! Mishandling the batteries can cause fires, explosions, leakages or other hazards!

-  Keep batteries out of the reach of children.
- Make sure that no one can swallow the batteries.

- If a battery is swallowed, seek medical assistance immediately.
- Always use the stated battery type.
-  Never try to recharge non-rechargeable batteries.
- Remove rechargeable batteries from the device before recharging them.
-   Do not throw batteries into a fire or water.
- Never expose batteries to high temperatures or direct sunlight.

-   Never open or deform batteries.
-  Do not short-circuit the terminals.
- Remove depleted batteries from the device and dispose of them safely.
-   Do not use different types of batteries together or mix new batteries with used batteries.
-   Always insert batteries into the device with the correct polarity.

- If you do not intend to use the device for an extended period, remove the batteries.
- Check the condition of the batteries at regular intervals. Leaking batteries can cause injuries as well as damage to the device.
- Always use protective gloves when handling leaking batteries! Clean the battery and device contacts and the battery compartment with a dry cloth. Do not let the chemicals get into contact with your skin and mucous membranes, especially your eyes.

In case of contact with chemicals, wash the affected area with plenty of water and immediately seek medical attention.

6. Device description

(See fold-out page for illustrations)

Figure A:

- ❶ Display
- ❷ Activation/function button 
- ❸ Finger opening
- ❹ Battery compartment cover (on the back side)
- ❺ Eye for carry strap

Figure B:

- ⑥ Battery charge indicator 
- ⑦ Pulse rate (beats per minute) PR bpm
- ⑧ Pulse bar
- ⑨ Pulse wave (plethysmographic wave)
- ⑩ Perfusion index **PI** %
- ⑪ Arterial haemoglobin oxygen saturation **%SpO₂**

Figure C:

- ⑫ Batteries

Figure D:

- ⑬ Carry strap

7. Getting started

- 1) Remove all parts of the device and the operating instructions from the packaging.
- 2) Remove all packaging materials and any films and labels.

7.1. Inserting/replacing the batteries

Note

- Always insert 2 alkaline batteries of type AAA (LR03) in the battery compartment.
 - 1) Slide the battery compartment cover  outwards.
 - 2) Remove the dead batteries if any are inserted.
 - 3) Insert 2 new batteries as shown in the polarity diagram in the battery compartment.
 - 4) Slide the battery compartment cover  back on so that it clicks into place.

Note

- If the batteries are almost empty, the text "LowPower" appears in the display **1** and the device switches off. Replace the batteries promptly.

7.2. Attaching the carry strap

- 1) Pull the thin part of the carry strap **13** through the eye for the carry strap **5**.
- 2) Guide the thicker part of the carry strap **13** through the loop (see Fig. D).

7.3. Taking a reading

- 1) Insert a finger into the finger opening **3**.
- 2) Press the Activation/Function button  **2** several times until the image from Illustration B on the fold-out page appears.
- 3) Wait a moment until the readings appear on the display **1**.

Note

- ▶ If no finger is inserted into the finger opening **3**, "Finger out" appears on the bottom of the display **1** and the device switches off.
- ▶ The device switches itself off automatically after a period of inactivity.

7.4. Evaluating the readings

 **WARNING!** The values given below do not apply to persons with preexisting health conditions, such as cardiac insufficiency or asthma, or at elevations above 1500 m. If you suffer from preexisting health conditions, always discuss the values with your doctor.

SpO₂ reading in %	Classification / Measures to be taken
99-94	Normal range
93-90	Low range: Consultation with a doctor recommended

SpO ₂ reading in %	Classification / Measures to be taken
<90	Critical range: Seek medical attention immediately!
Source: Adapted from "Windisch W et al. S2k-Leitlinie: Nichtinvasive und invasive Beatmung als Therapie der chronischen respiratorischen Insuffizienz – Revision 2017; Pneumologie 2017; 71: 722–795"	

Elevation-related decrease in oxygen saturation

i Note

- The following table describes the different effects of various elevations on the oxygen saturation value and on the human body. The values given below also do not apply to persons with preexisting health conditions, such as cardiac insufficiency or asthma and other respiratory diseases. In the case of preexisting health conditions, symptoms may occur already at lower elevations.

Elevations	Expected SpO ₂ value in %	Consequences for the person
1500–2500 m	> 90	No altitude sickness (generally)
2500–3000 m	~ 90	Altitude sickness, adaptation recommended
Source: Hackett PH, Roach RC: High-Altitude Medicine. In: Auerbach PS (ed): Wilderness Medicine, 3rd edition; Mosby, St. Louis, MO 1995; 1-37.		

7.5. Adjusting settings

- While the device is switched on, press the Activation/Function button  **2** again to switch between the various display modes.
- While the device is switched on, hold the Activation/Function button  **2** pressed to access the settings menu. Press the Activation/Function button  **2** again to

switch between the menu items. Hold the Activation/Function button  ② pressed to change the menu item marked with "*":

- "Alm": When this function is set to "on", a sound is played during readings.
- "Pulse Beep": If this function is set to "on", an alarm sounds at the configured pulse rate.
- "SpO₂ lo": Here you can set the minimum value for the oxygen saturation at which the alarm sounds.
- "PR Hi": Here you can set the maximum value for the pulse rate at which the alarm sounds.
- "PR Lo": Here you can set the minimum value for the pulse rate at which the alarm sounds.
- "Restore": This restores the factory default settings.
- "+/-": Here you can set whether the setting values will be increased or decreased.
- "Exit": Here you can leave the settings menu and return to measurement mode.

8. Cleaning

DANGER!

- ▶ Never immerse the device in water or other liquids!

ATTENTION!

- ▶ Do not use abrasive or caustic cleaning agents or solvents. These can attack the surface and damage the device beyond repair.
- Wipe the device with a damp cloth if necessary.

9. Storage

- If you do not intend to use the device for an extended period of time, remove the batteries.
- Store the device in a dust-free and dry location. Note the storage and transport conditions (see **11. Technical specifications**).

10. Disposal



The symbol of the crossed-out wheeled bin means that this appliance may not be disposed of in regular household waste at the end of its service life. The appliance must be deposited at an established collection point, recycling centre or disposal company.

Please erase all personal data before returning an appliance.

Before returning an appliance, please remove any batteries that are not permanently enclosed within the old appliance as well as any light sources that can be removed without destroying the appliance. Then dispose of these items separately.

If the rechargeable batteries are permanently installed, you must indicate during disposal that the appliance contains a battery.

The packaging is made from environmentally friendly material which can be disposed of at your local recycling plant.

Dispose of the packaging in an environmentally friendly manner.

10.1. Disposal of batteries



Batteries/rechargeable batteries must be treated as hazardous waste and must therefore be disposed of in an environmentally sound manner by appropriate bodies (dealers, specialist dealers, public municipal bodies, commercial disposal companies). Batteries/rechargeable batteries may contain toxic heavy metals.

The heavy metals contained are identified by letters below the symbol: Cd = cadmium, Hg = mercury, Pb = lead.

For this reason, do not dispose of batteries/rechargeable batteries in domestic waste. Take them to a specialist collection point.

Only return batteries that are fully discharged.

11. Technical specifications

Device name, model	SPO 3 A1
Measurement method	Non-invasive measurement of arterial haemoglobin oxygen saturation and pulse rate on the finger
Measuring range	SpO ₂ : 35~100% Pulse 30~250 beats/min.
Accuracy	SpO ₂ : 80%~100%: $\pm 2\%$; Pulse 30-250 ± 2 beats/min.
Max. measurement deviation of the pulse display	SpO ₂ : 1% Pulse rate 1 beats/min.

Operating conditions	+10 °C to +40 °C ambient temperature ≤ 75% relative humidity (non-condensing) 700–1060 hPA air pressure
Transport/storage conditions	–40 °C to +60 °C ambient temperature ≤ 95% relative humidity (non-condensing) 500–1060 hPA air pressure
Power supply	2 x 1.5 V ≡ AAA batteries (LR03)
Battery lifespan	2 AAA batteries allow 3 readings per day (60 seconds each) for about 2 years.
Dimensions (L x W x H)	63.7 x 35 x 35 mm
Weight	approx. 60 g (incl. batteries)
Classification	IP22

Information on electromagnetic compatibility

- The device is suitable for operation in all environments as indicated in these instructions for use, including domestic environments.

WARNING!

- This device corresponds to the standard EN 60601-1-2 and is subject to special precautionary measures with regard to electromagnetic compatibility. Please note that portable and mobile HF communication devices (including peripheral devices such as antenna cables and external antennas) may influence the performance of this device. Avoid strong electromagnetic interference during use, such as in the vicinity of mobile telephones, microwave ovens, etc. Keep the pulse oximeter at least 30 cm away from such devices.
- Using this device directly next to or stacked with other devices should be avoided as this can result in faulty operation.

If such use is necessary, this device and the other devices should be observed to ensure that they are functioning properly.

- The use of accessories, adapters and cables that are not specified or provided by the manufacturer can lead to increased electromagnetic emissions or reduced immunity to electromagnetic interference and can result in faulty operation of the device.
- Failure to follow this instruction can result in reduced device performance.
- This device cannot be used in an MRI environment.
- In some cases, the device may only be usable to a limited extent near sources of electromagnetic interference. This can result in erroneous readings or failure of the display/device.

Directives and standards

■ The device corresponds to the following standards, laws and regulations:

- EU Medical Devices Regulation (EU) 2017/745
- **RoHS Directive** (2011/65/EU)*

* The manufacturer bears the full responsibility for compliance with this conformity declaration. The object of the declaration described above complies with the requirements of the Directive 2011/65/EU of the European Parliament and Council of 8 June 2011 on the limitations of use of certain dangerous substances in electrical and electronic appliances.

- EN 60601-1
- EN 60601-1-2
- EN 60601-1-11
- DIN EN ISO 80601-2-61
- IEC 62471
- EN 60601-1-6
- EN 62366-1
- EN 62304

Reporting of undesired events for users/patients in EU countries

If users/patients are of the opinion that they have suffered a serious incident in connection with the product, such users/patients are requested to report the incident to the manufacturer and/or the manufacturer's authorised agent as well as to the competent authority of the Member State in which the users/patients are located.

12. Kompernass Handels GmbH warranty

Dear Customer,

This appliance has a 3-year warranty valid from the date of purchase. If this product has any faults, you, the buyer, have certain statutory rights. Your statutory rights are not restricted in any way by the warranty described below.

Warranty conditions

The warranty period starts on the date of purchase. Please keep your receipt in a safe place. This will be required as proof of purchase.

If any material or manufacturing fault occurs within three years of the date of purchase of the product, we will either repair or replace the product for you or refund the purchase price (at our discretion). This warranty service requires that you present the defective appliance and the proof of purchase (receipt) within the three-year warranty period, along with a brief written description of the fault and of when it occurred.

If the defect is covered by the warranty, your product will either be repaired or replaced by us. The repair or replacement of a product does not signify the beginning of a new warranty period.

Warranty period and statutory claims for defects

The warranty period is not prolonged by repairs effected under the warranty. This also applies to replaced and repaired components. Any damage and defects present at the time of purchase must be reported immediately after unpacking. Repairs carried out after expiry of the warranty period shall be subject to a fee.

Scope of the warranty

This appliance has been manufactured in accordance with strict quality guidelines and inspected meticulously prior to delivery.

The warranty covers material faults or production faults. The warranty does not extend to product parts subject to normal wear and tear or to fragile parts which could be considered as consumable parts such as switches or parts made of glass.

The warranty does not apply if the product has been damaged, improperly used or improperly maintained. The directions in the operating instructions for the product regarding proper use of the product are to be strictly followed. Uses and actions that are discouraged in the operating instructions or which are warned against must be avoided.

This product is intended solely for private use and not for commercial purposes. The warranty shall be deemed void in cases of misuse or improper handling, use of force and modifications / repairs which have not been carried out by one of our authorised Service centres.

Warranty claim procedure

To ensure quick processing of your case, please observe the following instructions:

- Please have the till receipt and the item number (IAN) 518645_2504 available as proof of purchase.

- You will find the item number on the type plate on the product, an engraving on the product, on the front page of the operating instructions (below left) or on the sticker on the rear or bottom of the product.
- If functional or other defects occur, please contact the service department listed either by **telephone** or by **e-mail**.
- You can return a defective product to us free of charge to the service address that will be provided to you. Ensure that you enclose the proof of purchase (till receipt) and information about what the defect is and when it occurred.



You can download these instructions along with many other manuals, product videos and installation software at www.lidl-service.com.

This QR code will take you directly to the Lidl service page (www.lidl-service.com) where you can open your operating instructions by entering the item number (IAN) 518645_2504.

12.1. Service

GB Service Great Britain

Tel.: 0800 404 7657

E-Mail: kompernass@lidl.co.uk

IE Service Ireland

Tel.: 1800 101010

E-Mail: kompernass@lidl.ie

MT Service Malta

Tel.: 80062230

E-Mail: kompernass@lidl.com.mt

IAN 518645_2504

12.2. Importer

Please note that the following address is not the service address.
Please use the service address provided in the operating instructions.

For EU market



KOMPERNASS HANDELS GMBH

BURGSTRASSE 21

44867 BOCHUM

GERMANY

www.kompernass.com

For GB market

Lidl Great Britain Ltd

Lidl House 14 Kingston Road

Surbiton

KT5 9NU

Inhaltsverzeichnis

1. Einführung	49
2. Bestimmungsgemäßer Gebrauch	49
2.1. Kontraindikationen	50
3. Lieferumfang	51
4. Verwendete Warnhinweise und Symbole	51
5. Sicherheitshinweise	59
5.1. Sicherheitshinweise zum Umgang mit Batterien	67
6. Gerätebeschreibung	71
7. Inbetriebnahme	73
7.1. Batterien einlegen/wechseln.	73
7.2. Halteband installieren.	74

7.3. Messung durchführen	74
7.4. Messwerte beurteilen	75
7.5. Einstellungen vornehmen.	77
8. Reinigen	79
9. Aufbewahren	80
10. Entsorgung	80
10.1. Batterien entsorgen	82
11. Technische Daten	83
12. Garantie der Kompernaß Handels GmbH	89
12.1. Service	93
12.2. Importeur	94

1. Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres neuen Gerätes.

Sie haben sich damit für ein hochwertiges Produkt entschieden. Die Bedienungsanleitung ist Bestandteil dieses Produkts. Sie enthält wichtige Hinweise für Sicherheit, Gebrauch und Entsorgung. Machen Sie sich vor der Benutzung des Produkts mit allen Bedien- und Sicherheitshinweisen vertraut. Benutzen Sie das Produkt nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung immer als Nachschlagewerk in der Nähe des Produkts auf. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Produkts an Dritte mit aus.

2. Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Dieses Gerät dient zur nicht invasiven Messung der arteriellen Sauerstoffsättigung des Hämoglobins und Pulsfrequenz am Finger von Erwachsenen. Die Sauerstoffsättigung ist ein wichtiger Indikator zur Bewertung der Atemfunktion.

Eine niedrige Sauerstoffsättigung kann auf eine Erkrankung, wie Asthma oder Herzinsuffizienz, hindeuten. Suchen Sie in diesem Falle umgehend einen Arzt auf!

Das Gerät ist nicht geeignet für die Anwendung an Neugeborenen und Kleinkindern, sowie für Personen mit schweren Herzrhythmusstörungen.

Das Gerät ist für die Selbstmessung geeignet. Es sind keine besonderen Fachkenntnisse gefordert, der Patient kann das Gerät selbst bedienen.

Dieses Gerät ist ausschließlich für die Benutzung in privaten Haushalten bestimmt. Benutzen Sie das Gerät nicht gewerblich oder industriell.

2.1. Kontraindikationen

Während der Schwangerschaft empfehlen wir, sich vor der Verwendung mit einem Arzt abzustimmen. Präeklampsie-Patientinnen dürfen das Gerät nicht nutzen.

Das Gerät ist für Patienten mit implantierten elektrischen Geräten wie Herzschrittmacher oder Defibrillatoren nicht geeignet. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Sie Metallimplantate haben.

3. Lieferumfang

Der Lieferumfang besteht aus folgenden Komponenten:

- Pulsoximeter
- 2 x Alkaline-Batterien Micro AAA (LR03)
- Halteband
- Bedienungsanleitung

4. Verwendete Warnhinweise und Symbole

In der vorliegenden Bedienungsanleitung, auf der Verpackung und dem Gerät werden folgende Warnhinweise und Symbole verwendet (falls zutreffend):



GEFAHR! Ein Warnhinweis mit diesem Symbol und dem Signalwort „GEFAHR“ kennzeichnet eine unmittelbar bevorstehende Gefährdungssituation, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge hat.

	WARNUNG! Ein Warnhinweis mit diesem Symbol und dem Signalwort „WARNUNG“ kennzeichnet eine mögliche Gefährdungssituation, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben könnte.
	VORSICHT! Ein Warnhinweis mit diesem Symbol und dem Signalwort „VORSICHT“ kennzeichnet eine mögliche Gefährdungssituation, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine geringfügige oder mäßige Verletzung zur Folge haben könnte.
	ACHTUNG! Ein Warnhinweis mit diesem Symbol und dem Signalwort „ACHTUNG“ kennzeichnet eine mögliche Situation, die, wenn sie nicht vermieden wird, einen Sachschaden zur Folge haben könnte.
	Hinweis: Ein Hinweis kennzeichnet zusätzliche Informationen, die den Umgang mit dem Gerät erleichtern.

	Anleitung beachten! Vor Beginn der Arbeit und/oder dem Bedienen von Geräten oder Maschinen die Anleitung lesen.
	Gleichstrom/-spannung
	Medizinisches Produkt
	Importeur
	Typ BF: Das Gerät wurde so entwickelt, dass der Patient gegen elektrischer Schlag geschützt ist.
IP22	Geschützt gegen Fremdkörper $\geq 12,5$ mm und gegen schräges Tropfwasser
%SpO₂	Arterielle Sauerstoffsättigung des Hämoglobins (in Prozent)

PR bpm	Pulsfrequenz (Pulsschläge pro Minute)
PI %	Der Perfusionsindex (PI) ist das Verhältnis vom pulsatilen Blutfluss zum nicht-pulsatilen Blutfluss im peripheren Gewebe des Patienten.
	Batteriezustandsanzeige
	Herstellungsjahr/Monat
	Unique Device Identifier: Kennung zur eindeutigen Produktidentifikation
	Seriennummer
	Artikelnummer

	Typennummer
	Temperaturbereich
	Feuchtigkeitsbereich
	Luftdruckbereich
	Elektrogerät nicht in den Hausmüll entsorgen!

	Führen Sie die Verpackung einer umweltgerechten Entsorgung zu.
	Verwendbar bis
	Verpackung aus recyclebaren Materialien. Beachten Sie die Kennzeichnung der Verpackungsmaterialien bei der Abfalltrennung: Diese sind gekennzeichnet mit Abkürzungen (a) und Ziffern (b) mit folgender Bedeutung: 1-7: Kunststoffe, 20-22: Papier und Pappe, 80-98: Verbundstoffe.



Die Verpackung enthält Bestandteile aus Papier und/oder Pappe.



Die Verpackung enthält Bestandteile aus Plastik und/oder Metall.

ES/PT



Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der geltenden europäischen und nationalen Richtlinien.



Dieses Zeichen bestätigt, dass das Produkt den in Großbritannien geltenden Anforderungen an die Produktsicherheit entspricht.



Herstelleradresse: Shenzhen BSX Technology Electronics Co., Ltd.
Rm101,2/F~4/F, Building no.13, Ailian Industrial Park, Wulian Community, Longgang District, Shenzhen 518116 Guangdong, P.R. China



Bevollmächtigter in der Europäischen Gemeinschaft / Europäischen Union: MedNet EC-REP GmbH
Borkstrasse 10, 48163 Münster, Germany



FR: Das Produkt, die Verpackung und die Bedienungsanleitung sind recycelbar, unterliegen einer erweiterten Herstellerverantwortung und werden getrennt gesammelt.

5. Sicherheitshinweise

WARNUNG!

- Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.

- Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Sie elektrische Implantate haben (z. B. Herzschrittmacher).
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Sie Metallimplantate haben.
- Verwenden Sie das Gerät nicht bei Neugeborenen, Kindern und Haustieren.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Sie allergisch auf Gummiprodukte reagieren.

- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Gerät oder der Anwendungsfinger feucht ist.
- Verwenden Sie das Gerät nicht während einer Blutdruckmessung auf der Armseite mit Manschetteneanwendung.
- Verwenden Sie das Gerät nicht an Fingern mit Nagellack, Beschmutzungen oder Pflasterverbänden.
- Verwenden Sie das Gerät nicht an Fingern mit großer Fingerdicke, die nicht zwanglos in das Gerät einführbar sind. Ebenso nicht an zu kleinen Fingern.

- Verwenden Sie das Gerät nicht an Fingern mit anatomischen Veränderungen, Ödemen, Narben, Nagellack, Kunstnägeln andere Kosmetika oder Verbrennungen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht an Patienten, die am Anwendungsort unruhig sind (z. B. Zittern).
- Verwenden Sie das Gerät nicht länger als ca. 2 Stunden an einem Finger.
- Schauen Sie während des Betriebes nicht in das Gehäuseinnere. Das Licht könnte die Augen schädigen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von starken Lichtquellen.

- Die von Ihnen selbst ermittelten Messwerte können nur zur Selbstkontrolle dienen – sie ersetzen keine ärztliche Untersuchung! Besprechen Sie Ihre Werte mit Ihrem Arzt. Begründen Sie auf keinen Fall eigene medizinische Entscheidungen (Medikamente und deren Dosierung) darauf!
- Herz-Kreislauf-Erkrankungen können zu Fehlmessungen bzw. zu einer Beeinträchtigung der Messgenauigkeit führen. Dies gilt auch bei sehr niedrigem Blutdruck, Diabetes, Durchblutungs- und Herzrhythmusstörungen sowie bei Schüttelfrost oder Zittern.

- Die Anzeige der Messwerte erlauben keine sichere Pulsdiagnostik, sondern dienen ausschließlich der Darstellung der aktuellen optischen Signalvariation am Messort.
- Führen Sie ohne Rücksprache mit Ihrem behandelnden Arzt keine Selbstdiagnose oder -behandlung aufgrund der Messergebnisse durch. Führen Sie insbesondere nicht eigenmächtig eine Änderung in Art und/oder Dosierung einer bestehenden Medikation durch und setzen Sie keine eigene Medikation an.

- Das Gerät kann nur einen momentanen Messwert anzeigen und kann nicht für eine kontinuierliche Überwachung verwendet werden.

❗ **ACHTUNG!**

- Verwenden Sie nur Zubehör, das im Lieferumfang enthalten ist oder vom Hersteller empfohlen wird.
- Schützen Sie das Gerät vor Feuchtigkeit, Staub, hohen Temperaturen und direkter Sonneneinstrahlung.
- Wenn das Gerät bei einer Temperatur nahe den Grenzwerten für die Lager- und Transporttemperatur gelagert

wurde und in eine Umgebung mit 20 °C verbracht wird, warten Sie vor der Verwendung ca. 2 Stunden, um das Gerät auf Raumtemperatur zu bringen.

- Sie dürfen das Gerätegehäuse nicht öffnen, zerlegen oder reparieren. Die Sicherheit ist nicht gegeben und die Garantie erlischt.
- Lassen Sie das Gerät nicht fallen und setzen Sie es keinen starken Erschütterungen aus.
- Da das Gerät empfindliche elektronische Komponenten enthält, vermeiden Sie den direkten Einsatz in einer starken

elektromagnetischen Umgebung (z. B. Mobiltelefon, Mikrowellenherd, etc.), da dies zu ungenauen Ergebnissen führen kann.

5.1. Sicherheitshinweise zum Umgang mit Batterien

⚠️ WARNING! Eine falsche Handhabung von Batterien kann zu Feuer, Explosionen, Auslaufen gefährlicher Stoffe oder anderen Gefahrensituationen führen!

-  Lassen Sie niemals zu, dass Batterien in die Hände von Kindern gelangen.
- Achten Sie darauf, dass niemand Batterien verschluckt.

- Nehmen Sie sofort medizinische Hilfe in Anspruch, wenn Sie oder eine andere Person eine Batterie verschluckt hat.
- Verwenden Sie ausschließlich den angegebenen Batterietyp.
-  Laden Sie nicht-wiederaufladbare Batterien niemals wieder auf.
- Entfernen Sie wiederaufladbare Batterien aus dem Gerät, bevor diese geladen werden.
-   Werfen Sie Batterien niemals in Feuer oder Wasser.

- Setzen Sie Batterien keinen hohen Temperaturen und direkter Sonneneinstrahlung aus.
-   Öffnen oder verformen Sie niemals Batterien.
-  Schließen Sie die Anschlussklemmen nicht kurz.
- Entfernen Sie leere Batterien aus dem Gerät und entsorgen Sie sie sicher.
-   Verwenden Sie keine unterschiedlichen Batterietypen oder neue und gebrauchte Batterien zusammen.

-  Setzen Sie Batterien immer mit der richtigen Polarität in das Gerät ein.
- Entnehmen Sie die Batterien, wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht verwenden.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Batterien. Auslaufende Batterien können zu Verletzungen führen und Beschädigungen am Gerät verursachen.
- Verwenden Sie bei ausgelaufenen Batterien Schutzhandschuhe! Reinigen Sie die Batterie- und Gerätekontakte sowie das Batteriefach mit einem trockenen Tuch.
Vermeiden Sie den Kontakt von Haut und Schleimhäuten

insbesondere Ihrer Augen mit den Chemikalien. Spülen Sie bei Kontakt die Chemikalien mit viel Wasser ab und nehmen sofort medizinische Hilfe in Anspruch.

6. Gerätebeschreibung

(Abbildungen siehe Ausklappseite)

Abbildung A:

- ❶ Display
- ❷ Einschalt-/Funktionstaste 
- ❸ Fingeröffnung
- ❹ Batteriefachdeckel (auf der Rückseite)
- ❺ Öse für Halteband

Abbildung B:

- ⑥ Batteriezustandsanzeige 
- ⑦ Pulsfrequenz (Pulsschläge pro Minute) PR bpm
- ⑧ Pulssäule
- ⑨ Pulswelle (plethysmografische Welle)
- ⑩ Perfusionsindex **PI** %
- ⑪ Arterielle Sauerstoffsättigung des Hämoglobins **%SpO₂**

Abbildung C:

- ⑫ Batterien

Abbildung D:

- ⑬ Halteband

7. Inbetriebnahme

- 1) Entnehmen Sie alle Teile des Gerätes und die Bedienungsanleitung aus der Verpackung.
- 2) Entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial und eventuelle Folien und Aufkleber.

7.1. Batterien einlegen/wechseln

Hinweis

- Setzen Sie immer nur 2 Alkaline-Batterien des Typs AAA (LR03) in das Batteriefach ein.
 - 1) Schieben Sie den Batteriefachdeckel  nach außen.
 - 2) Falls eingesetzt, entfernen Sie die verbrauchten Batterien.
 - 3) Legen Sie 2 neuen Batterien gemäß der im Batteriefach gezeigten Polarität ein.
 - 4) Schieben Sie den Batteriefachdeckel  wieder auf, sodass er einrastet.

Hinweis

- ▶ Wenn die Batterien fast aufgebraucht sind, erscheint im Display **1** die Aufschrift „LowPower“ und das Gerät schaltet sich ab. Wechseln Sie umgehend die Batterien.

7.2. Halteband installieren

- 1) Ziehen Sie den dünnen Teil des Haltebands **13** durch die Öse für das Halteband **5**.
- 2) Führen Sie den dickeren Teil des Haltebands **13** durch die Schlinge (s. Abb D).

7.3. Messung durchführen

- 1) Schieben Sie einen Finger in die Fingeröffnung **3**.
- 2) Drücken Sie die Einschalt-/Funktionstaste  **2**, mehrmals, bis die Darstellung B) auf der Ausklappseite erscheint.
- 3) Warten Sie einen Moment bis, die Messwerte im Display **1** erscheinen.

Hinweis

- Sollte kein Finger in die Fingeröffnung **3** eingeführt sein, erscheint „Finger out“ unten im Display **1** und das Gerät schaltet sich ab.
- Das Gerät schaltet sich nach einer Weile Inaktivität automatisch ab.

7.4. Messwerte beurteilen

 **WARNUNG!** Die im folgendem aufgeführten Werte gelten nicht bei Personen mit Vorerkrankungen, wie z.B. Herzinsuffizienz, Asthma und bei einem Aufenthalt in Höhen über 1 500 m. Wen Sie unter Vorerkrankungen leiden, besprechen Sie die Werte immer mit Ihrem Arzt.

Messergebnis SpO ₂ in %	Einstufung/zu ergreifende Maßnahmen
99-94	Normalbereich

Messergebnis SpO ₂ in %	Einstufung/zu ergreifende Maßnahmen
93–90	Niedriger Bereich: Arztbesuch empfohlen
<90	Kritischer Bereich: Suchen Sie dringend einen Arzt auf!
Quelle: In Anlehnung an „Windisch W et al. S2k-Leitlinie: Nichtinvasive und invasive Beatmung als Therapie der chronischen respiratorischen Insuffizienz – Revision 2017; Pneumologie 2017; 71: 722–795“	

Höhenabhängiger Sauerstoffsättigungsabfall

Hinweis

- Der nachfolgenden Tabelle können Sie die unterschiedlichen Auswirkungen unterschiedlicher Höhenlagen auf den Sauerstoffsättigungswert und den menschlichen Organismus entnehmen. Die im folgendem aufgeführten Werte gelten ebenfalls nicht

bei Personen mit Vorerkrankungen, wie z.B. Herzinsuffizienz, Asthma und anderen Atemwegserkrankungen. Bei Vorerkrankungen können Krankheitssymptome bereits in niedrigeren Höhenlagen auftreten.

Höhenlagen	Zu erwartender SpO_2 -Wert in %	Folgen für den Menschen
1500–2500 m	> 90	Keine Höhenkrankheit (in der Regel)
2500–3000 m	~ 90	Höhenkrankheit, Anpassung empfohlen
Quelle: Hackett PH, Roach RC: High-Altitude Medicine. In: Auerbach PS (ed): Wilderness Medicine, 3rd edition; Mosby, St. Louis, MO 1995; 1-37.		

7.5. Einstellungen vornehmen

- Drücken Sie bei eingeschaltetem Gerät erneut die Einschalt-/Funktionstaste  ②, um zwischen verschiedenen Displayanzeigen zu wechseln.

- Halten Sie bei eingeschaltetem Gerät die Einschalt-/Funktionstaste  **2** gedrückt, um das Einstellungsmenü aufzurufen. Drücken Sie erneut die Einschalt-/Funktionstaste  **2**, um zwischen den Menüpunkten zu wechseln. Halten Sie die Einschalt-/Funktionstaste  **2** gedrückt, um den markierten „*“ Menüpunkt zu ändern:
- „Alm“: Wenn diese Funktion auf „on“ gesetzt ist, ertönt ein Geräusch bei den Messungen.
 - „Pulse Beep“: Wenn diese Funktion auf „on“ gesetzt ist, ertönt ein Alarm bei der eingestellten Pulsrate.
 - „SpO₂ lo“: Hier kann ein Mindestwert für die Sauerstoffsättigung eingestellt werden, bei dem der Alarm ertönt.
 - „PR Hi“: Hier kann ein Höchststwert für die Pulsfrequenz eingestellt werden, bei dem der Alarm ertönt.
 - „PR Lo“: Hier kann ein Mindestwert für die Pulsfrequenz eingestellt werden, bei dem der Alarm ertönt.

- „Restore“: Hier können die Werkseinstellungen wiederhergestellt werden.
- „+/-“: Hier kann eingestellt werden, ob die Einstellungswerte erhöht oder verringert werden sollen.
- „Exit“: Hier können Sie das Einstellungs Menü verlassen und zum Messmodus zurückkehren.

8. Reinigen

GEFAHR!

- ▶ Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten!

ACHTUNG!

- ▶ Benutzen Sie keine scheuernden oder ätzenden Reinigungsmittel oder Lösungsmittel. Diese können die Oberfläche angreifen und das Gerät irreparabel beschädigen.
- Wischen Sie das Gerät gegebenenfalls mit einem feuchten Tuch ab.

9. Aufbewahren

- Wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen, entfernen Sie die Batterien.
- Bewahren Sie das Gerät an einem staubfreien und trockenen Ort auf. Beachten Sie die Lagerungs- und Transportbedingungen (siehe **11. Technische Daten**).

10. Entsorgung



Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne bedeutet, dass dieses Gerät am Ende der Nutzungszeit nicht über den Hausmüll entsorgt werden darf. Das Gerät ist bei eingerichteten Sammelstellen, Wertstoffhöfen oder Entsorgungsbetrieben abzugeben.

Für den deutschen Markt gilt:

Zudem sind Vertreiber von Elektro- und Elektronikgeräten sowie Vertreiber von Lebensmitteln zur Rücknahme verpflichtet. LIDL bietet Ihnen Rückgabemöglichkeiten direkt in den Filialen und Märkten an. Rückgabe und Entsorgung sind für Sie kostenfrei.

Beim Kauf eines Neugerätes haben Sie das Recht, ein entsprechendes Altgerät unentgeltlich zurückzugeben. Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit, unabhängig vom Kauf eines Neugerätes, unentgeltlich (bis zu drei) Altgeräte abzugeben, die in keiner Abmessung größer als 25 cm sind.

Bitte löschen Sie vor der Rückgabe alle personenbezogenen Daten.

Bitte entnehmen Sie vor der Rückgabe Batterien oder Akkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sowie Lampen, die zerstörungsfrei entnommen werden können und führen diese einer separaten Sammlung zu.

Bitte löschen Sie vor der Rückgabe alle personenbezogenen Daten.

Bitte entnehmen Sie vor der Rückgabe Batterien oder Akkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sowie Lampen, die zerstörungsfrei entnommen werden können und führen diese einer separaten Sammlung zu.

Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien, die Sie über die örtlichen Recyclingstellen entsorgen können.

Entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht.

10.1. Batterien entsorgen



Batterien/Akkus sind als Sondermüll zu behandeln und müssen daher durch entsprechende Stellen (Händler, Fachhändler, öffentliche kommunale Stellen, gewerbliche Entsorgungsunternehmen) umweltgerecht entsorgt werden. Batterien/Akkus können giftige Schwermetalle enthalten.

Gekennzeichnet werden die enthaltenen Schwermetalle mit Buchstaben unter dem Symbol: Cd = Cadmium, Hg = Quecksilber, Pb = Blei.

Werfen Sie Batterien/Akkus daher nicht in den Hausmüll, sondern führen Sie diese einer separaten Sammlung zu. Geben Sie Batterien/Akkus nur im entladenen Zustand zurück.

11. Technische Daten

Gerätename, Modell	SPO 3 A1
Messmethode	nicht invasive Messung der arteriellen Sauerstoffsättigung des Hämoglobins und Pulsfrequenz am Finger
Messbereich	SpO ₂ : 35~100% Puls 30~250 Schläge/Min.
Genauigkeit	SpO ₂ : 80%~100%: $\pm 2\%$; Puls 30-250 ± 2 Schläge/Min.
Max. Messabweichung der Pulsanzeige	SpO ₂ : 1% Pulsrate 1 Schlag/Min.

Betriebsbedingungen	+10 °C bis +40 °C Umgebungstemperatur ≤ 75% relative Luftfeuchte (nicht kondensierend) 700–1060 hPA Luftdruck
Transport-/ Lagerbedingungen	–40 °C bis 60 °C Umgebungstemperatur ≤ 95% relative Luftfeuchte (nicht kondensierend) 500–1060 hPA Luftdruck
Stromversorgung	2 x 1,5 V  AAA Batterien (LR03)
Batterielebensdauer	2 AAA Batterien ermöglichen ca. 2 Jahre Betrieb bei 3 Messungen pro Tag (je 60 Sekunden).
Abmessungen (L x B x H)	63,7 x 35 x 35 mm
Gewicht	ca. 60 g (inkl. Batterien)
Klassifikation	IP22

Hinweise zur elektromagnetischen Verträglichkeit

- Das Gerät ist für den Betrieb in allen Umgebungen geeignet, die in dieser Bedienungsanleitung angegeben sind, einschließlich der häuslichen Umgebung.

WARNUNG!

- Dieses Gerät entspricht der Norm EN 60601-1-2 und unterliegt besonderen Vorsichtsmaßnahmen hinsichtlich der elektromagnetischen Verträglichkeit. Bitte beachten Sie dabei, dass tragbare und mobile HF-Kommunikationseinrichtungen (einschließlich Peripheriegeräte wie Antennenkabel und externe Antennen) die Leistung dieses Gerätes beeinflussen können. Vermeiden Sie bei der Verwendung starke elektromagnetische Störungen, wie z. B. in der Nähe von Mobiltelefonen, Mikrowellengeräten u. Ä. Halten Sie das Pulsoximeter mindestens 30 cm fern von solchen Geräten.
- Die Verwendung dieses Gerätes unmittelbar neben oder mit anderen Geräten in gestapelter Form sollte vermieden werden, da dies zu einer fehlerhaften Betriebsweise führen kann.

Wenn eine solche Verwendung notwendig ist, sollten das Gerät und die anderen Geräte beobachtet werden, um sicherzustellen, dass sie ordnungsgemäß funktionieren.

- Die Verwendung von Zubehör, Wandlern und Kabeln, die nicht vom Hersteller festgelegt oder bereitgestellt wurden, kann zu erhöhten elektromagnetischen Emissionen oder einer verringerten elektromagnetischen Störfestigkeit des Geräts führen und eine fehlerhafte Betriebsweise zur Folge haben.
- Eine Nichtbeachtung kann zu einer Minderung der Geräteleistung führen.
- Dieses Gerät kann nicht in einer MRT-Umgebung verwendet werden.
- Das Gerät kann in der Gegenwart von elektromagnetischen Störgrößen unter Umständen nur in eingeschränktem Maße nutzbar sein. Infolgedessen können z. B. Fehlermeldungen oder ein Ausfall des Displays/Gerätes auftreten.

Richtlinien und Normen

■ Das Gerät entspricht folgenden Normen, Gesetzen und Verordnungen:

- EU-Verordnung über Medizinprodukte MDR (EU) 2017/745
- **RoHS-Richtlinie** (2011/65/EU)*

* Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller. Der oben beschriebene Gegenstand der Erklärung erfüllt die Vorschriften der Richtlinie 2011/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2011 zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten.

- EN 60601-1
- EN 60601-1-2
- EN 60601-1-11
- DIN EN ISO 80601-2-61

- IEC 62471
- EN 60601-1-6
- EN 62366-1
- EN 62304

Meldung unerwünschter Ereignisse für Anwender/Patienten in EU-Ländern

Wenn Anwender/Patienten der Meinung sind, dass bei Ihnen ein schwerwiegender Zwischenfall im Zusammenhang mit dem Produkt aufgetreten ist, werden die Anwender/Patienten aufgefordert, den Zwischenfall dem Hersteller und/oder seinem Bevollmächtigten sowie der zuständigen Behörde des Mitgliedstaates, in dem der Anwender/Patient sich befindet, zu melden.

12. Garantie der Kompernaß Handels GmbH

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

Sie erhalten auf dieses Gerät 3 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Im Falle von Mängeln dieses Produkts stehen Ihnen gegen den Verkäufer des Produkts gesetzliche Rechte zu. Diese gesetzlichen Rechte werden durch unsere im Folgenden dargestellte Garantie nicht eingeschränkt.

Garantiebedingungen

Die Garantiefrist beginnt mit dem Kaufdatum. Bitte bewahren Sie den Kassenbon gut auf. Dieser wird als Nachweis für den Kauf benötigt.

Tritt innerhalb von drei Jahren ab dem Kaufdatum dieses Produkts ein Material- oder Fabrikationsfehler auf, wird das Produkt von uns – nach unserer Wahl – für Sie kostenlos repariert, ersetzt oder der Kaufpreis erstattet. Diese Garantieleistung setzt voraus, dass innerhalb der Dreijahresfrist das defekte Gerät und der Kaufbeleg (Kassenbon) vorgelegt und schriftlich kurz beschrieben wird, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist.

Wenn der Defekt von unserer Garantie gedeckt ist, erhalten Sie das reparierte oder ein neues Produkt zurück. Mit Reparatur oder Austausch des Produkts beginnt kein neuer Garantiezeitraum.

Garantiezeit und gesetzliche Mängelansprüche

Die Garantiezeit wird durch die Gewährleistung nicht verlängert. Dies gilt auch für ersetzte und reparierte Teile. Eventuell schon beim Kauf vorhandene Schäden und Mängel müssen sofort nach dem Auspacken gemeldet werden. Nach Ablauf der Garantiezeit anfallende Reparaturen sind kostenpflichtig.

Garantieumfang

Das Gerät wurde nach strengen Qualitätsrichtlinien sorgfältig produziert und vor Auslieferung gewissenhaft geprüft.

Die Garantieleistung gilt für Material- oder Fabrikationsfehler. Diese Garantie erstreckt sich nicht auf Produktteile, die normaler Abnutzung ausgesetzt sind und daher als Verschleißteile angesehen werden können oder für Beschädigungen an zerbrechlichen Teilen, z. B. Schalter oder Teile, die aus Glas gefertigt sind.

Diese Garantie verfällt, wenn das Produkt beschädigt, nicht sachgemäß benutzt oder gewartet wurde. Für eine sachgemäße Benutzung des Produkts sind alle in der Bedienungsanleitung aufgeführten Anweisungen genau einzuhalten. Verwendungszwecke und Handlungen, von denen in der Bedienungsanleitung abgeraten oder vor denen gewarnt wird, sind unbedingt zu vermeiden.

Das Produkt ist nur für den privaten und nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt. Bei missbräuchlicher und unsachgemäßer Behandlung, Gewaltanwendung und bei Eingriffen, die nicht von unserer autorisierten Serviceniederlassung vorgenommen wurden, erlischt die Garantie.

Abwicklung im Garantiefall

Um eine schnelle Bearbeitung Ihres Anliegens zu gewährleisten, folgen Sie bitte den folgenden Hinweisen:

- Bitte halten Sie für alle Anfragen den Kassenbon und die Artikelnummer (IAN) 518645_2504 als Nachweis für den Kauf bereit.

- Die Artikelnummer entnehmen Sie bitte dem Typenschild am Produkt, einer Gravur am Produkt, dem Titelblatt der Bedienungsanleitung (unten links) oder dem Aufkleber auf der Rück- oder Unterseite des Produktes.
- Sollten Funktionsfehler oder sonstige Mängel auftreten, kontaktieren Sie zunächst die nachfolgend benannte Serviceabteilung **telefonisch** oder per **E-Mail**.
- Ein als defekt erfasstes Produkt können Sie dann unter Beifügung des Kaufbelegs (Kassenbon) und der Angabe, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist, für Sie portofrei an die Ihnen mitgeteilte Serviceanschrift übersenden.



Auf www.lidl-service.com können Sie diese und viele weitere Handbücher, Produktvideos und Installationssoftware herunterladen.

Mit diesem QR-Code gelangen Sie direkt auf die Lidl-Service-Seite (www.lidl-service.com) und können durch die Eingabe der Artikelnummer (IAN) 518645_2504 Ihre Bedienungsanleitung öffnen.

12.1. Service

- DE Service Deutschland** Tel.: 0800 5435 111
(kostenfrei aus dem dt. Festnetz / Mobilfunknetz)
E-Mail: kompernass@lidl.de
- AT Service Österreich** Tel.: 0800 447 744
E-Mail: kompernass@lidl.at
- BE Service Belgien** Tel.: 0800 12089
E-Mail: kompernass@lidl.be
- CH Service Schweiz** Tel.: 0800 56 44 33
E-Mail: kompernass@lidl.ch

IAN 518645_2504

12.2. Importeur

Bitte beachten Sie, dass die folgende Anschrift keine Serviceanschrift ist.
Kontaktieren Sie zunächst die benannte Servicestelle.

Für den EU-Markt



KOMPERNASS HANDELS GMBH
BURGSTRASSE 21
44867 BOCHUM
DEUTSCHLAND
www.kompernass.com

Für den GB-Markt

Lidl Great Britain Ltd
Lidl House 14 Kingston Road
Surbiton
KT5 9NU

Table des matières

1. Introduction	97
2. Utilisation conforme à l'usage prévu	97
2.1. Contre-indications	98
3. Matériel fourni	99
4. Avertissements et symboles utilisés	99
5. Avertissements de sécurité	107
5.1. Consignes de sécurité relatives à l'utilisation des piles	116
6. Description de l'appareil	120
7. Mise en service	121
7.1. Insertion/remplacement des piles	122
7.2. Installation de la dragonne	123

7.3. Effectuer la mesure	123
7.4. Analyse des valeurs mesurées	124
7.5. Réalisation des réglages	126
8. Nettoyage	128
9. Rangement	128
10. Recyclage	129
10.1. Recyclage des piles/batteries	130
11. Caractéristiques techniques	131
12. Garantie pour Kompernass Handels GmbH (France)	137
13. Garantie pour Kompernass Handels GmbH (Belgique/Suisse)	144
14. Service après-vente	149
15. Importateur	150

1. Introduction

Toutes nos félicitations pour l'achat de votre nouvel appareil.

Vous venez ainsi d'opter pour un produit de grande qualité. Le mode d'emploi fait partie intégrante de ce produit. Il contient des remarques importantes concernant la sécurité, l'utilisation et le recyclage. Avant d'utiliser le produit, veuillez vous familiariser avec toutes les consignes d'utilisation et avertissements de sécurité. N'utilisez le produit que conformément aux descriptions et pour les domaines d'utilisation prévus. Conservez toujours le mode d'emploi comme ouvrage de référence à proximité du produit. Si vous cédez le produit à un tiers, remettez-lui également tous les documents.

2. Utilisation conforme à l'usage prévu

Cet appareil sert à mesurer sur des adultes, de manière non invasive, la saturation en oxygène de l'hémoglobine dans le sang artériel et la fréquence du pouls au niveau du doigt. La saturation en oxygène est un indicateur important servant à évaluer la fonction respiratoire.

Une saturation en oxygène faible peut être le signe d'une maladie comme l'asthme, ou d'une insuffisance cardiaque. Dans ce cas, consultez immédiatement un médecin ! L'appareil ne convient pas à une utilisation sur des nouveau-nés et enfants en bas âge, ni sur des personnes souffrant de troubles sévères du rythme cardiaque. L'appareil est adapté à l'autocontrôle. Aucune connaissance technique spécifique n'étant nécessaire, le patient peut se servir lui-même de l'appareil. Cet appareil est exclusivement réservé à un usage domestique. N'utilisez pas l'appareil à des fins commerciales ou industrielles.

2.1. Contre-indications

En cas de grossesse, il est recommandé d'obtenir l'avis d'un médecin avant l'utilisation. Les patientes souffrant de pré-éclampsie ne doivent pas utiliser cet appareil. L'appareil n'est pas adapté aux patients porteurs de dispositifs électriques implantés tels que des stimulateurs cardiaques ou défibrillateurs. N'utilisez pas l'appareil si vous portez des implants métalliques.

3. Matériel fourni

Le matériel livré comprend les éléments suivants :

- Oxymètre de pouls
- 2 piles alcalines Micro AAA (LR03)
- Dragonne
- Mode d'emploi

4. Avertissements et symboles utilisés

Les avertissements et symboles suivants sont utilisés (s'il y a lieu) dans le présent mode d'emploi, sur l'emballage et sur l'appareil :



DANGER ! Un avertissement accompagné de ce symbole et de la mention « DANGER » désigne une situation dangereuse imminente qui, si elle n'est pas évitée, a pour conséquence d'entraîner la mort ou une blessure grave.

	AVERTISSEMENT ! Un avertissement accompagné de ce symbole et de la mention « AVERTISSEMENT » annonce une situation possiblement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner la mort ou une blessure grave.
	PRUDENCE ! Un avertissement accompagné de ce symbole et de la mention « PRUDENCE » désigne une situation possiblement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, pourrait occasionner une blessure légère ou modérée.
	ATTENTION ! Un avertissement accompagné de ce symbole et de la mention « ATTENTION » désigne une situation susceptible d'occasionner des dégâts matériels si elle n'est pas évitée.
	Remarque : une remarque comporte des informations supplémentaires facilitant la manipulation de l'appareil.

	Observer le mode d'emploi ! Lire le mode d'emploi avant de commencer le travail et/ou d'utiliser des appareils ou machines.
	Courant/tension continu(e)
	Dispositif médical
	Importateur
	Type BF : l'appareil a été conçu de manière à protéger le patient contre les décharges électriques.
IP22	Protection contre les corps étrangers $\geq 12,5$ mm et contre les gouttes d'eau projetées en biais

%SpO₂	Saturation en oxygène de l'hémoglobine dans le sang artériel (en pourcentage)
PR bpm	Fréquence du pouls (pulsations par minute)
PI %	L'indice de perfusion (PI) représente le rapport entre la circulation sanguine pulsatile et la circulation sanguine non pulsatile dans les tissus périphériques du patient.
	Indicateur d'état des piles
	Année de fabrication/mois
	Unique Device Identifier : code unique identifiant le dispositif
	Numéro de série

	Référence
	Numéro de type
	Plage de température
	Plage d'humidité
	Plage de pression de l'air
	Ne pas jeter les appareils électriques dans les ordures ménagères !

	Recyclez l'emballage en respectant les règles environnementales.
	Utilisable jusqu'à
	Emballage en matériaux recyclables. Pour le tri des déchets, respectez l'identification des matériaux d'emballage : ils sont repérés par des abréviations (a) et des numéros (b) qui ont la signification suivante : 1-7 : plastiques, 20-22 : papier et carton, 80-98 : matériaux composites.

  ES/PT	L'emballage se compose d'éléments en papier et/ou en carton. L'emballage se compose d'éléments en plastique et/ou en métal.
	Ce produit répond aux exigences des directives européennes et nationales applicables.
	Ce symbole atteste que le produit répond aux exigences en vigueur en Grande-Bretagne en matière de sécurité des produits.



Adresse du fabricant : Shenzhen BSX Technology Electronics Co., Ltd.
Rm101,2/F~4/F, Building no.13, Ailian Industrial Park, Wulian Community, Longgang District, Shenzhen 518116 Guangdong, P.R. China



Représentant dans la Communauté européenne / l'Union européenne :
MedNet EC-REP GmbH, Borkstrasse 10, 48163 Münster, Germany



FR

Cet appareil,
ses accessoires
et piles
se recyclent

À DÉPOSER
EN MAGASIN



À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



ou

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



FR



+



FR



Le produit, l'emballage et le mode d'emploi sont recyclables. Ils sont soumis à la responsabilité élargie du producteur (REP), selon laquelle ils doivent être collectés séparément.

5. Avertissements de sécurité

AVERTISSEMENT !

- Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales présentent des déficiences, ou par des personnes dénuées d'expérience ou de connaissances, à moins d'être surveillées par une personne chargée de leur sécurité ou d'avoir reçu d'elle des instructions concernant l'utilisation de l'appareil.

- Il faut surveiller les enfants pour être sûr qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- N'utilisez pas l'appareil si vous portez des implants électriques (p. ex., stimulateur cardiaque).
- N'utilisez pas l'appareil si vous portez des implants métalliques.
- N'utilisez pas l'appareil sur des nouveau-nés, des enfants ni sur des animaux domestiques.
- N'utilisez pas l'appareil si vous êtes allergique aux produits en caoutchouc.

- N'utilisez pas l'appareil si l'appareil ou le doigt utilisé sont humides.
- N'utilisez pas l'appareil pendant la prise, sur le même bras, de la tension artérielle avec un brassard.
- N'utilisez pas l'appareil sur des doigts vernis, sales ou recouverts d'un pansement.
- N'utilisez pas l'appareil sur des doigts épais qui ne rentrent pas facilement dans l'appareil. Ni sur des doigts trop petits.

- N'utilisez pas l'appareil sur des doigts présentant des transformations anatomiques, des œdèmes, des cicatrices, des brûlures, dont les ongles sont vernis, avec de faux ongles ou d'autres produits cosmétiques.
- N'utilisez pas l'appareil sur des patients qui sont nerveux sur le lieu de l'utilisation (p. ex., tremblements).
- N'utilisez pas l'appareil plus de 2 heures environ sur un même doigt.
- Pendant l'utilisation, ne regardez pas à l'intérieur du boîtier. La lumière peut endommager les yeux.

- N'utilisez pas l'appareil à proximité de sources lumineuses puissantes.
- Les valeurs mesurées que vous obtenez vous-même ne servent qu'à un autocontrôle, elles ne remplacent aucunement un examen médical ! Discutez des valeurs obtenues avec votre médecin. Ne vous en servez en aucun cas pour prendre vos propres décisions médicales (médicaments et leur posologie) !
- Des maladies cardiovasculaires peuvent donner lieu à des mesures erronées ou compromettre la précision de la mesure.

Cela vaut également en cas de tension très basse, de diabète, de troubles circulatoires et du rythme cardiaque, ainsi qu'en cas de frissons ou de tremblements.

- Les valeurs mesurées affichées ne permettent pas de poser un diagnostic sûr concernant le pouls, elles servent uniquement à représenter de manière optique la variation actuelle du signal sur le lieu de mesure.
- Sans concertation avec votre médecin traitant, ne posez pas vous-même un diagnostic ou ne prenez pas un traitement sur la base des résultats de mesure.

Notamment, ne modifiez pas de vous-même le type et/ou le dosage d'un traitement médicamenteux et ne pratiquez pas l'automédication.

- L'appareil ne peut afficher qu'une valeur de mesure instantanée et ne peut pas être utilisé pour une surveillance continue.

ⓘ **ATTENTION !**

- N'utilisez que les accessoires fournis avec l'appareil ou recommandés par le fabricant.

- Protégez l'appareil de l'humidité, de la poussière, des températures élevées et du rayonnement solaire direct.
- Si l'appareil a été stocké à une température proche des valeurs limites applicables au stockage et au transport, et qu'il est amené dans un environnement à 20 °C, attendez env. 2 heures avant de l'utiliser, pour lui laisser le temps de prendre la température ambiante.
- N'ouvrez pas le boîtier de l'appareil, ne le démontez pas et ne le réparez pas. La sécurité n'est plus assurée et la garantie est annulée.

- Ne laissez pas tomber l'appareil et ne l'exposez pas à des chocs violents.
- Étant donné que l'appareil contient des composants électroniques sensibles, évitez de l'utiliser directement dans un environnement fortement électromagnétique (p. ex. téléphone mobile, four à micro-ondes, etc.), car cela peut provoquer des résultats imprécis.

5.1. Consignes de sécurité relatives à l'utilisation des piles

⚠ AVERTISSEMENT ! Une manipulation incorrecte des piles peut entraîner un incendie, des explosions, une fuite de substances dangereuses ou d'autres situations dangereuses !

-  Tenez toujours les piles hors de portée des enfants.
- Veillez à ce que personne n'avale de pile.
- Si vous ou une autre personne avez avalé une pile, consultez immédiatement un médecin.
- Utilisez exclusivement le type de pile indiqué.

-  Ne rechargez jamais des piles non rechargeables.
- Avant de recharger des piles rechargeables, retirez-les de l'appareil.
-   Ne jetez jamais les piles au feu ou dans l'eau.
- N'exposez jamais les piles à des températures élevées ou au rayonnement direct du soleil.
-   N'ouvrez ou ne déformez jamais des piles.
-  Ne court-circuitez pas les bornes de raccordement.

- Retirez les piles usagées de l'appareil et veillez à leur recyclage sûr.
-  N'utilisez pas de types de piles différents ou de piles neuves et usagées ensemble.
-  Placez toujours les piles avec la bonne polarité dans l'appareil.
- En cas d'inutilisation prolongée de l'appareil, retirez les piles.
- Vérifiez régulièrement les piles. Les piles qui fuient peuvent provoquer des blessures et endommager l'appareil.

- Enfilez des gants avant de manipuler des piles qui ont fui ! Nettoyez les contacts des piles et de l'appareil ainsi que le compartiment à piles avec un chiffon sec. Évitez tout contact de la peau et des muqueuses, et notamment des yeux, avec les produits chimiques. En cas de contact, rincez les produits chimiques avec beaucoup d'eau et consultez immédiatement un médecin.

6. Description de l'appareil

(Figures : voir le volet dépliant)

Figure A :

- 1 Écran
- 2 Touche d'allumage/de fonction 
- 3 Ouverture pour le doigt
- 4 Couvercle du compartiment à piles (à l'arrière)
- 5 Oeillet de dragonne

Figure B :

- 6 Indicateur d'état des piles 
- 7 Fréquence du pouls (pulsations par minute) PR bpm
- 8 Barre du pouls

- ⑨ Onde du pouls (onde pléthysmographique)
- ⑩ Indice de perfusion **PI** %
- ⑪ Saturation en oxygène de l'hémoglobine dans le sang artériel %**SpO₂**

Figure C :

- ⑫ Piles

Figure D :

- ⑬ Dragonne

7. Mise en service

- 1) Sortez de l'emballage toutes les pièces de l'appareil et le mode d'emploi.
- 2) Enlevez tout le matériel d'emballage, les éventuels films et autocollants.

7.1. Insertion/remplacement des piles

Remarque

- Introduisez uniquement 2 piles alcalines de type AAA (LR03) dans le compartiment à piles.

- 1) Faites coulisser le couvercle du compartiment à piles  vers l'extérieur.
- 2) Retirez les piles usagées du compartiment si présentes.
- 3) Insérez les 2 piles neuves conformément à la polarité figurant dans le compartiment à piles.
- 4) Remettez le couvercle du compartiment à piles en place  (il doit s'encliqueter).

Remarque

- Lorsque les piles sont presque vides, la mention « LowPower » s'affiche sur l'écran  et l'appareil s'éteint. Changez immédiatement les piles.

7.2. Installation de la dragonne

- 1) Enfilez la partie fine de la dragonne ⑬ dans l'œillet de dragonne ⑤.
- 2) Enfilez la partie plus épaisse de la dragonne ⑬ dans la boucle (voir fig. D).

7.3. Effectuer la mesure

- 1) Glissez un doigt dans l'ouverture pour le doigt ③.
- 2) Appuyez sur la touche d'allumage/de fonction  ② plusieurs fois jusqu'à ce que l'image B) sur le volet dépliant apparaisse.
- 3) Attendez un moment jusqu'à ce que les valeurs mesurées apparaissent à l'écran ①.

Remarque

- Si aucun doigt n'est introduit dans l'ouverture pour le doigt ③, « Finger out » apparaît en bas à l'écran ① et l'appareil s'éteint.
- L'appareil s'éteint automatiquement au bout d'un certain temps d'inactivité.

7.4. Analyse des valeurs mesurées

⚠️ AVERTISSEMENT ! Les valeurs mentionnées ci-après ne s'appliquent pas aux personnes souffrant de maladies préexistantes, p. ex. insuffisance cardiaque, asthme et en cas de séjour à des altitudes supérieures à 1 500 m. Si vous souffrez de maladies préexistantes, discutez toujours des valeurs avec votre médecin.

Résultat de mesure SpO ₂ en %	Classification/mesures à prendre
99-94	Plage normale
93-90	Plage basse : visite chez le médecin recommandée
<90	Plage critique : consultez urgemment un médecin !

Résultat de mesure SpO ₂ en %	Classification/mesures à prendre
Source : En référence à la « directive Windisch W et al. S2k : Ventilation non invasive et invasive en tant que traitement de l'insuffisance respiratoire chronique – Révision 2017 ; Pneumologie 2017 ; 71 : 722-795 »	

Chute de la saturation en oxygène liée à l'altitude

i Remarque

- Vous pouvez consulter dans le tableau ci-après les différents effets de diverses altitudes sur la valeur de la saturation en oxygène et sur l'organisme humain. Les valeurs mentionnées ci-après ne s'appliquent pas non plus aux personnes souffrant de maladies préexistantes, p. ex. insuffisance cardiaque, asthme et autres maladies des voies respiratoires. En cas de maladies préexistantes, des symptômes de la maladie peuvent apparaître déjà à basse altitude.

Altitudes	Valeur SpO ₂ , en %, à attendre	Conséquences pour l'être humain
1500-2500 m	> 90	Pas de mal des montagnes (en règle générale)
2500-3000 m	~ 90	Mal des montagnes, ajustement recommandé
Source : Hackett PH, Roach RC : High-Altitude Medicine. In : Auerbach PS (ed) : Wilderness Medicine, 3rd edition ; Mosby, St. Louis, MO 1995 ; 1-37.		

7.5. Réalisation des réglages

- Lorsque l'appareil est allumé, appuyez à nouveau sur la touche d'allumage/de fonction  ② pour basculer entre les différents affichages de l'écran.
- Lorsque l'appareil est allumé, maintenez la touche d'allumage/de fonction  ② appuyée pour appeler le menu des réglages. Appuyez à nouveau sur la touche d'allumage/de fonction  ② pour basculer entre les points de menu.

Maintenez la touche d'allumage/de fonction  ② appuyée pour modifier le point de menu « * » sélectionné :

- « Alm » : lorsque cette fonction est réglée sur « on », un bruit retentit lors des mesures.
- « Pulse Beep » : lorsque cette fonction est réglée sur « on », une alarme retentit lorsque le taux d'impulsions réglé est atteint.
- « SpO₂ lo » : il est possible ici de régler une valeur minimale de saturation en oxygène à laquelle l'alarme retentit.
- « PR Hi » : il est possible ici de régler une valeur maximale de fréquence du pouls à laquelle l'alarme retentit.
- « PR lo » : il est possible ici de régler une valeur minimale de fréquence du pouls à laquelle l'alarme retentit.
- « Restore » : il est possible ici de restaurer les réglages usine.
- « +/- » : il est possible ici de régler si les valeurs de réglage doivent être augmentées ou diminuées.
- « Exit » : vous pouvez ici quitter le menu des réglages et revenir au mode de mesure.

8. Nettoyage

DANGER !

- ▶ N'immergez jamais l'appareil dans de l'eau ni dans d'autres liquides !

ATTENTION !

- ▶ N'utilisez pas de produits nettoyants abrasifs ou corrosifs ni de solvants. Ils peuvent en effet aggraver la surface et endommager l'appareil de manière irréparable.
- Essayez également l'appareil avec un chiffon humide.

9. Rangement

- Si vous n'utilisez pas l'appareil pendant une durée prolongée, retirez les piles.
- Conservez l'appareil dans un endroit sec et exempt de poussières. Respectez les conditions de stockage et de transport (voir **11. Caractéristiques techniques**).

10. Recyclage



Le symbole de la poubelle barrée signifie que cet appareil ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères à la fin de sa période d'utilisation. L'appareil doit être remis aux points de collecte établis, aux déchetteries ou aux entreprises chargées du recyclage.

Veuillez effacer toutes vos données personnelles avant le retour.

Avant le retour, veuillez retirer les piles ou batteries qui ne sont pas enfermées dans l'ancien appareil, ainsi que les lampes pouvant être retirées sans destruction et recyclez-les séparément.

Pour les batteries inamovibles, il convient de signaler leur présence dans l'appareil au moment de le rapporter au recyclage.

L'emballage est constitué de matériaux écologiques que vous pouvez recycler par le biais des services de recyclage locaux.

Éliminez l'emballage dans le respect de l'environnement.

10.1. Recyclage des piles/batteries



Les piles/batteries doivent être traitées comme des déchets spéciaux devant être obligatoirement recyclés dans le respect de l'environnement par les entités correspondantes (commerçants, revendeurs spécialisés, services municipaux, entreprises de recyclage professionnel). Les piles/batteries peuvent contenir des métaux lourds toxiques.

Les métaux lourds qu'elles contiennent sont repérés par les lettres suivantes sous le symbole : Cd = cadmium, Hg = mercure, Pb = plomb.

Par conséquent, ne jetez pas les piles/batteries dans les ordures ménagères, rappez-les au contraire à un point de collecte séparé.

Ne rappez les piles/batteries qu'à l'état déchargé.

11. Caractéristiques techniques

Nom de l'appareil, modèle	SPO 3 A1
Méthode de mesure	Mesure, non invasive, de la saturation en oxygène de l'hémoglobine dans le sang artériel, et de la fréquence du pouls sur le doigt
Plage de mesure	SpO ₂ : 35~100 % Pouls 30~250 battements/min
Précision	SpO ₂ : 80 %~100 % : ± 2 %; Pouls 30-250 ± 2 battements/min
Écart de mesure max. de l'indicateur du pouls	SpO ₂ : 1 % Taux d'impulsions 1 battement/min

Conditions d'utilisation	Température ambiante entre +10 °C et +40 °C Humidité relative de l'air (sans condensation) ≤ 75 % Pression de l'air 700 – 1060 hPA
Conditions de transport/ stockage	Température ambiante entre -40 °C et +60 °C Humidité relative de l'air (sans condensation) ≤ 95 % Pression de l'air 500 – 1060 hPA
Alimentation électrique	2 piles de 1,5 V  AAA (LR03)
Durée de vie des piles	2 piles AAA permettent env. 2 ans d'utilisation à raison de 3 mesures par jour (60 secondes chacune).
Dimensions (L x l x H)	63,7 x 35 x 35 mm
Poids	env. 60 g (piles incl.)
Classification	IP22

Informations concernant la compatibilité électromagnétique

- L'appareil convient à une utilisation dans tous les environnements indiqués dans le présent mode d'emploi, y compris dans l'environnement domestique.

AVERTISSEMENT !

- L'appareil est conforme à la norme EN 60601-1-2 et fait l'objet de mesures de précaution spécifiques en ce qui concerne la compatibilité électromagnétique. Veuillez noter à ce sujet que les dispositifs de communication HF portatifs et mobiles (y compris des périphériques tels que des câbles d'antenne et des antennes externes) peuvent influencer la performance de l'appareil. Pendant l'utilisation, évitez les perturbations électromagnétiques intenses telles que celles présentes notamment à proximité de téléphones mobiles, fours à micro-ondes et similaires. Maintenez l'oxymètre de pouls à une distance d'au moins 30 cm de tels appareils.

- L'utilisation de cet appareil à proximité immédiate d'autres appareils ou en superposition avec d'autres appareils devrait être évitée car cela pourrait perturber son fonctionnement.
Si une telle forme d'utilisation est nécessaire, il faut observer cet appareil et les autres appareils pour s'assurer qu'ils fonctionnent correctement.
- L'utilisation d'accessoires, convertisseurs et câbles qui n'ont pas été spécifiés ou fournis par le fabricant peut conduire à des émissions électromagnétiques accrues ou réduire l'immunité électromagnétique de cet appareil et provoquer un dysfonctionnement.
- Le non-respect de ce qui précède peut compromettre les performances de l'appareil.
- Cet appareil ne peut pas être utilisé dans un environnement où se pratiquent des examens IRM.
- Dans certaines circonstances, l'appareil ne peut être utilisé que de façon limitée en présence de perturbations électromagnétiques. Il peut en résulter notamment des messages d'erreur ou une panne de l'écran/l'appareil.

Directives et normes

- L'appareil est conforme aux normes, lois et ordonnances suivantes :
 - Règlement européen sur les dispositifs médicaux MDR (UE) 2017/745
 - **Directive RoHS** (2011/65/EU)*
- * La seule responsabilité pour l'établissement de cette déclaration de conformité incombe au fabricant. L'objet de la déclaration décrit ci-dessus répond aux prescriptions de la directive 2011/65/EU du Parlement européen et du Conseil en date du 8 juin 2011 visant la restriction de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques.
- EN 60601-1
- EN 60601-1-2
- EN 60601-1-11

- DIN EN ISO 80601-2-61
- IEC 62471
- EN 60601-1-6
- EN 62366-1
- EN 62304

Notification d'événements indésirables, par les utilisateurs/patients dans les pays de l'Union européenne

Si des utilisateurs/patients estiment qu'un incident grave s'est produit en lien avec leur utilisation du produit, ces utilisateurs/patients sont invités à notifier cet incident au fabricant et/ou à son mandataire, ainsi qu'à l'autorité compétente dans l'État membre où se trouve l'utilisateur/le patient.

12. Garantie pour Kompernass Handels GmbH (France)

Chère cliente, cher client,

Cet appareil est garanti 3 ans à partir de la date d'achat. Si ce produit venait à présenter des vices, vous disposez de droits légaux face au vendeur de ce produit. Vos droits légaux ne sont pas restreints par notre garantie présentée ci-dessous.

Conditions de garantie

La période de garantie débute à la date d'achat. Veuillez bien conserver le ticket de caisse. Celui-ci servira de preuve d'achat.

Si dans un délai de trois ans suivant la date d'achat de ce produit, un vice de matériel ou de fabrication venait à apparaître, le produit sera réparé, remplacé gratuitement par nos soins ou le prix d'achat remboursé, selon notre choix. Cette prestation sous garantie nécessite, dans le délai de trois ans, la présentation de l'appareil défectueux et du justificatif d'achat (ticket de caisse) ainsi que la description brève du vice et du moment de son apparition.

Si le vice est couvert par notre garantie, vous recevrez le produit réparé ou un nouveau produit en retour. Aucune nouvelle période de garantie ne débute avec la réparation ou l'échange du produit.

Période de garantie et réclamation légale pour vices cachés

L'exercice de la garantie ne prolonge pas la période de garantie. Cette disposition s'applique également aux pièces remplacées ou réparées. Les dommages et vices éventuellement déjà présents à l'achat doivent être signalés immédiatement après le déballage. Toute réparation survenant après la période sous garantie fera l'objet d'une facturation.

Étendue de la garantie

L'appareil a été fabriqué avec soin conformément à des directives de qualité strictes et consciencieusement contrôlé avant sa livraison.

La prestation de la garantie s'applique aux vices de matériel et de fabrication. Cette garantie ne s'étend pas aux pièces du produit qui sont exposées à une usure normale et

peuvent de ce fait être considérées comme pièces d'usure, ni aux détériorations de pièces fragiles, par ex. interrupteurs ou pièces en verre.

Cette garantie devient caduque si le produit est détérioré, utilisé ou entretenu de manière non conforme. Toutes les instructions listées dans le manuel d'utilisation doivent être exactement respectées pour une utilisation conforme du produit. Des buts d'utilisation et actions qui sont déconseillés dans le manuel d'utilisation, ou dont vous êtes avertis doivent également être évités.

Le produit est uniquement destiné à un usage privé et ne convient pas à un usage professionnel. La garantie est annulée en cas d'entretien incorrect et inapproprié, d'usage de la force et en cas d'intervention non réalisée par notre centre de service après-vente agréé.

Article L217-16 du Code de la consommation

Lorsque l'acheteur demande au vendeur, pendant le cours de la garantie commerciale qui lui a été consentie lors de l'acquisition ou de la réparation d'un bien meuble, une remise en état couverte par la garantie, toute période d'immobilisation d'au moins sept jours vient

s'ajouter à la durée de la garantie qui restait à courir. Cette période court à compter de la demande d'intervention de l'acheteur ou de la mise à disposition pour réparation du bien en cause, si cette mise à disposition est postérieure à la demande d'intervention.

Indépendamment de la garantie commerciale souscrite, le vendeur reste tenu des défauts de conformité du bien et des vices rédhibitoires dans les conditions prévues aux articles L217-4 à L217-13 du Code de la consommation et aux articles 1641 à 1648 et 2232 du Code Civil.

Article L217-4 du Code de la consommation

Le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.

Article L217-5 du Code de la consommation

Le bien est conforme au contrat :

- 1° S'il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :
 - s'il correspond à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ;
 - s'il présente les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;
- 2° Ou s'il présente les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.

Article L217-12 du Code de la consommation

L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien.

Article 1641 du Code civil

Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

Article 1648 1er alinéa du Code civil

L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.

Les pièces détachées indispensables à l'utilisation du produit sont disponibles pendant la durée de la garantie du produit.

Procédure en cas de garantie

Afin de garantir un traitement rapide de votre demande, veuillez suivre les indications suivantes :

- Veuillez avoir à portée de main pour toutes questions le ticket de caisse et la référence article (IAN) 518645_2504 en tant que justificatif de votre achat.
- Vous trouverez la référence sur la plaque signalétique sur le produit, une gravure sur le produit, sur la page de garde du mode d'emploi (en bas à gauche) ou sur l'auto-collant au dos ou sur le dessous du produit.
- Si des erreurs de fonctionnement ou d'autres vices venaient à apparaître, veuillez d'abord contacter le département service clientèle cité ci-dessous par **téléphone** ou par **e-mail**.
- Vous pouvez ensuite retourner un produit enregistré comme étant défectueux en joignant le ticket de caisse et en indiquant en quoi consiste le vice et quand il est survenu, sans devoir l'affranchir à l'adresse de service après-vente communiquée.



Sur www.lidl-service.com, vous pourrez télécharger ce mode d'emploi et de nombreux autres manuels, vidéos produit et logiciels d'installation.

Grâce à ce code QR, vous arriverez directement sur le site Lidl service après-vente (www.lidl-service.com) et vous pourrez ouvrir votre mode d'emploi en saisissant votre référence (IAN) 518645_2504.

13. Garantie pour Kompernass Handels GmbH (Belgique/Suisse)

Chère cliente, cher client,

Cet appareil est garanti 3 ans à partir de la date d'achat. Si ce produit venait à présenter des vices, vous disposez de droits légaux face au vendeur de ce produit. Vos droits légaux ne sont pas restreints par notre garantie présentée ci-dessous.

Conditions de garantie

La période de garantie débute à la date d'achat. Veuillez bien conserver le ticket de caisse. Celui-ci servira de preuve d'achat.

Si dans un délai de trois ans suivant la date d'achat de ce produit, un vice de matériel ou de fabrication venait à apparaître, le produit sera réparé, remplacé gratuitement par nos soins ou le prix d'achat remboursé, selon notre choix. Cette prestation sous garantie nécessite, dans le délai de trois ans, la présentation de l'appareil défectueux et du justificatif d'achat (ticket de caisse) ainsi que la description brève du vice et du moment de son apparition.

Si le vice est couvert par notre garantie, vous recevrez le produit réparé ou un nouveau produit en retour. Aucune nouvelle période de garantie ne débute avec la réparation ou l'échange du produit.

Période de garantie et réclamation légale pour vices cachés

L'exercice de la garantie ne prolonge pas la période de garantie. Cette disposition s'applique également aux pièces remplacées ou réparées.

Les dommages et vices éventuellement déjà présents à l'achat doivent être signalés immédiatement après le déballage. Toute réparation survenant après la période sous garantie fera l'objet d'une facturation.

Étendue de la garantie

L'appareil a été fabriqué avec soin conformément à des directives de qualité strictes et consciencieusement contrôlé avant sa livraison.

La prestation de la garantie s'applique aux vices de matériel et de fabrication. Cette garantie ne s'étend pas aux pièces du produit qui sont exposées à une usure normale et peuvent de ce fait être considérées comme pièces d'usure, ni aux détériorations de pièces fragiles, par ex. interrupteurs ou pièces en verre.

Cette garantie devient caduque si le produit est détérioré, utilisé ou entretenu de manière non conforme. Toutes les instructions listées dans le manuel d'utilisation doivent être exactement respectées pour une utilisation conforme du produit. Des buts d'utilisation et actions qui sont déconseillés dans le manuel d'utilisation, ou dont vous êtes avertis doivent également être évités.

Le produit est uniquement destiné à un usage privé et ne convient pas à un usage professionnel. La garantie est annulée en cas d'entretien incorrect et inapproprié, d'usage de la force et en cas d'intervention non réalisée par notre centre de service après-vente agréé.

Procédure en cas de garantie

Afin de garantir un traitement rapide de votre demande, veuillez suivre les indications suivantes :

- Veuillez avoir à portée de main pour toutes questions le ticket de caisse et la référence article (IAN) 518645_2504 en tant que justificatif de votre achat.
- Vous trouverez la référence sur la plaque signalétique sur le produit, une gravure sur le produit, sur la page de garde du mode d'emploi (en bas à gauche) ou sur l'auto-collant au dos ou sur le dessous du produit.
- Si des erreurs de fonctionnement ou d'autres vices venaient à apparaître, veuillez d'abord contacter le département service clientèle cité ci-dessous par **téléphone** ou par **e-mail**.

- Vous pouvez ensuite retourner un produit enregistré comme étant défectueux en joignant le ticket de caisse et en indiquant en quoi consiste le vice et quand il est survenu, sans devoir l'affranchir à l'adresse de service après-vente communiquée.



Sur www.lidl-service.com, vous pourrez télécharger ce mode d'emploi et de nombreux autres manuels, vidéos produit et logiciels d'installation.

Grâce à ce code QR, vous arriverez directement sur le site Lidl service après-vente (www.lidl-service.com) et vous pourrez ouvrir votre mode d'emploi en saisissant votre référence (IAN) 518645_2504.

14. Service après-vente

FR

Service France

Tel.: 0800 919270

E-Mail: kompernass@lidl.fr

BE

Service Belgique

Tel.: 0800 12089

E-Mail: kompernass@lidl.be

CH

Service Suisse

Tel.: 0800 56 44 33

E-Mail: kompernass@lidl.ch

IAN 518645_2504

15. Importateur

Veuillez tenir compte du fait que l'adresse suivante n'est pas une adresse de service après-vente. Veuillez d'abord contacter le service mentionné.

Pour le marché de l'UE



KOMPERNASS HANDELS GMBH
BURGSTRASSE 21
44867 BOCHUM
ALLEMAGNE
www.kompernass.com

Pour le marché du Royaume-Uni

Lidl Great Britain Ltd
Lidl House 14 Kingston Road
Surbiton
KT5 9NU

Inhoud

1. Inleiding	153
2. Gebruik in overeenstemming met de bestemming	153
2.1. Contra-indicaties	154
3. Inhoud van de levering	155
4. Gebruikte waarschuwingen en pictogrammen	155
5. Veiligheidsvoorschriften	163
5.1. Veiligheidsvoorschriften voor de omgang met batterijen	171
6. Apparaatbeschrijving	175
7. Ingebruikname	177
7.1. Batterijen plaatsen/vervangen	177
7.2. Draagband installeren	178

7.3. Meting uitvoeren	178
7.4. Meetwaarden beoordelen	179
7.5. Instellingen uitvoeren	181
8. Reinigen	183
9. Opbergen	184
10. Afvoeren	184
10.1. Batterijen/accu's afvoeren	185
11. Technische gegevens	186
12. Garantie van Kompernaß Handels GmbH	192
12.1. Service	196
12.2. Importeur	197

1. Inleiding

Hartelijk gefeliciteerd met de aankoop van uw nieuwe apparaat.

U hebt hiermee gekozen voor een hoogwaardig product. De gebruiksaanwijzing maakt deel uit van dit product. Hij bevat belangrijke aanwijzingen voor de veiligheid, het gebruik en het afvoeren van dit product. Maak u vertrouwd met alle bedienings- en veiligheidsaanwijzingen voordat u het product in gebruik neemt. Gebruik het product uitsluitend op de voorgeschreven wijze en voor de aangegeven doeleinden. Bewaar de gebruiksaanwijzing altijd als naslagwerk in de buurt van het product. Geef alle documenten mee als u het product doorgeeft aan derden.

2. Gebruik in overeenstemming met de bestemming

Dit apparaat dient voor de niet-invasieve meting van de arteriële zuurstofverzadiging van hemoglobine en de hartslag op de vinger van volwassenen. Zuurstofverzadiging is een belangrijke indicator voor de beoordeling van de ademhalingsfunctie.

Een lage zuurstofverzadiging kan wijzen op een aandoening zoals astma of hartfalen. Raadpleeg in dat geval onmiddellijk een arts!

Het apparaat is niet geschikt voor gebruik bij pasgeborenen en kleine kinderen of voor mensen met ernstige hartritmestoornissen.

Het apparaat is geschikt voor zelfmeting. Er is geen speciale vakkennis nodig; de patiënt kan het apparaat zelf bedienen.

Dit apparaat is uitsluitend bestemd voor gebruik in privéhuishoudens. Gebruik het apparaat niet voor commerciële of industriële doeleinden.

2.1. Contra-indicaties

Tijdens de zwangerschap raden we aan om vóór gebruik een arts te raadplegen.

Patiënten met zwangerschapsvergiftiging mogen het apparaat niet gebruiken.

Het apparaat is niet geschikt voor patiënten met geïmplanteerde elektrische apparaten zoals pacemakers of defibrillators. Gebruik het apparaat niet als u metalen implantaten hebt.

3. Inhoud van de levering

Het pakket bevat de volgende onderdelen:

- Pulsoximeter
- 2 x alkalinebatterijen Micro AAA (LR03)
- Draagband
- Gebruiksaanwijzing

4. Gebruikte waarschuwingen en pictogrammen

In deze gebruiksaanwijzing, op de verpakking en op het apparaat worden de volgende waarschuwingen en pictogrammen gebruikt (indien van toepassing):



GEVAAR! Een waarschuwing met dit pictogram en met het signaalwoord "GEVAAR" duidt op een onmiddellijk aanwezige gevaarlijke situatie die fataal of ernstig letsel tot gevolg heeft als deze niet wordt vermeden.



WAARSCHUWING! Een waarschuwing met dit pictogram en met het signaalwoord “WAARSCHUWING” duidt op een mogelijk gevaarlijke situatie die fataal of ernstig letsel tot gevolg kan hebben als deze niet wordt vermeden.



VOORZICHTIG! Een waarschuwing met dit pictogram en met het signaalwoord “VOORZICHTIG” duidt op een mogelijk gevaarlijke situatie die licht of matig letsel tot gevolg kan hebben als deze niet wordt vermeden.



LET OP! Een waarschuwing met dit pictogram en met het signaalwoord “LET OP” duidt op een mogelijke situatie die materiële schade tot gevolg kan hebben als deze niet wordt vermeden.



Opmerking: Een opmerking bevat extra informatie die de omgang met het apparaat eenvoudiger maakt.

	Gebruiksaanwijzing opvolgen! Lees de gebruiksaanwijzing voordat u met het werk begint en/of apparatuur of machines bedient.
	Gelijkstroom/-spanning
	Medisch product
	Importeur
	Type BF: het apparaat is ontworpen om de patiënt te beschermen tegen elektrische schokken.
IP22	Bescherming tegen vaste voorwerpen $\geq 12,5$ mm en tegen schuin druppelend water

%SpO₂	Arteriële zuurstofverzadiging van de hemoglobine (procentueel)
PR bpm	Hartslag (hartslagen per minuut)
PI %	De perfusie-index (PI) is de verhouding tussen de pulserende bloedstroom en de niet-pulserende bloedstroom in het perifere weefsel van de patiënt.
	Indicatie batterijtoestand
	Productiejaar/-maand
	Unique Device Identifier: code voor unieke productidentificatie
	Serienummer

	Artikelnummer
	Typenummer
	Temperatuurbereik
	Luchtvochtigheidsbereik
	Luchtdrukbereik
	Elektrisch apparaat niet met het gewone huisvuil meegeven!

	Voer de verpakking af in overeenstemming met de milieuvorschriften.
	Te gebruiken tot
	Verpakking van recyclebare materialen. Neem de aanduiding van de verpakkingsmaterialen in acht bij de afvalscheiding: de verpakkingsmaterialen zijn voorzien van afkortingen (a) en cijfers (b) met de volgende betekenis: 1-7: kunststoffen, 20-22: papier en karton, 80-98: composietmaterialen.

  ES/PT	De verpakking bevat bestanddelen van papier en/of karton. De verpakking bevat bestanddelen van plastic en/of metaal.
	Dit product voldoet aan de eisen van de toepasselijke Europese en nationale richtlijnen.
	Dit keurmerk bevestigt dat het product voldoet aan de productveiligheidseisen die van toepassing zijn in Groot-Brittannië.



Adres fabrikant: Shenzhen BSX Technology Electronics Co., Ltd.
Rm101,2/F~4/F, Building no.13, Ailian Industrial Park, Wulian Community, Longgang District, Shenzhen 518116 Guangdong, P.R. China



Gemachtigd vertegenwoordiger in de Europese Gemeenschap/Europese Unie: MedNet EC-REP GmbH, Borkstraße 10, 48163 Münster, Duitsland



FR

Cet appareil,
ses accessoires
et piles
se recyclent

À DÉPOSER
EN MAGASIN



OU

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



FR



FR



FR: Het product, de verpakking en de gebruiksaanwijzing zijn recyclebaar, vallen onder de uitgebreide verantwoordelijkheid van de producent en worden gescheiden ingezameld.

5. Veiligheidsvoorschriften

WAARSCHUWING!

- Dit product is niet bedoeld voor gebruik door personen (met inbegrip van kinderen) met beperkte fysieke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of met gebrek aan ervaring en/of gebrek aan kennis, tenzij deze onder toezicht staan van een voor hun veiligheid verantwoordelijke persoon of van die persoon aanwijzingen krijgen voor het gebruik van het product.

- Bij kinderen is supervisie noodzakelijk om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen.
- Gebruik het apparaat niet als u een elektrisch implantaat hebt (bijv. een pacemaker).
- Gebruik het apparaat niet als u metalen implantaten hebt.
- Gebruik het apparaat niet bij pasgeboren baby's, kinderen of huisdieren.
- Gebruik het apparaat niet wanneer u allergisch reageert op rubberproducten.

- Gebruik het apparaat niet als het apparaat of de vinger waarop u het gebruikt vochtig is.
- Gebruik het apparaat niet tijdens een bloeddrukmeting aan de armzijde met aangebrachte manchet.
- Gebruik het apparaat niet op vingers met nagellak, vuil of pleisters.
- Gebruik het apparaat niet op te dikke vingers die niet gemakkelijk in het apparaat kunnen worden gestoken. En evenmin op vingers die te klein zijn.

- Gebruik het apparaat niet op vingers met anatomische afwijkingen, oedeem, littekens, nagellak, kunstnagels, andere cosmetica of brandwonden.
- Gebruik het apparaat niet bij patiënten die onrustig zijn op de plaats van aanbrengen (bijv. trillen).
- Gebruik het apparaat niet langer dan ongeveer 2 uur op één vinger.
- Kijk tijdens het gebruik niet in de behuizing. Het licht kan oogletsel veroorzaken.
- Gebruik het apparaat niet in de buurt van sterke lichtbronnen.

- De meetwaarden die u zelf vaststelt, kunnen alleen worden gebruikt voor zelfcontrole, ze vervangen geen medisch onderzoek! Bespreek uw waarden met uw arts. Baseer hier nooit uw eigen medische beslissingen (medicatie en dosering) op!
- Hart- en vaatziekten kunnen leiden tot onjuiste metingen of een verminderde meetnauwkeurigheid. Dit geldt ook voor zeer lage bloeddruk, diabetes, doorbloedings- en hartritmestoornissen en koude rillingen of tremor.
- De weergave van de meetwaarden maakt geen betrouwbare hartslagdiagnose mogelijk, maar dient uitsluitend

om de huidige optische signaalvariatie op het meetpunt weer te geven.

- Voer geen zelfdiagnose of behandeling uit op basis van de meetresultaten zonder uw behandelend arts te raadplegen. Verander met name niet op eigen initiatief het type en/of de dosering van bestaande medicatie en begin niet met uw eigen medicatie.
- Het apparaat kan alleen een kortstondige meetwaarde weergeven en kan niet worden gebruikt voor continue bewaking.

⚠ **LET OP!**

- Gebruik uitsluitend accessoires die zijn meegeleverd of die door de fabrikant worden aanbevolen.
- Bescherm het apparaat tegen vocht, stof, hoge temperaturen en rechtstreeks zonlicht.
- Wanneer het apparaat opgeborgen is bij een temperatuur in de buurt van de grenswaarden voor de opslag- en transporttemperatuur en naar een omgeving met een temperatuur van 20 °C wordt overbracht, moet u voor gebruik ca. 2 uur wachten om het apparaat op ruimtemperatuur te laten komen.

- Open, demonteer of repareer de behuizing van het apparaat nooit. De veiligheid is dan niet gegarandeerd en de garantie vervalt.
- Laat het apparaat niet vallen en stel het niet bloot aan sterke schokken.
- Aangezien het apparaat gevoelige elektronische onderdelen bevat, moet direct gebruik in een sterk elektromagnetische omgeving (bijv. mobiele telefoon, magnetron, enz.) worden vermeden, omdat dit kan leiden tot onnauwkeurige resultaten.

5.1. Veiligheidsvoorschriften voor de omgang met batterijen

⚠ WAARSCHUWING! Een verkeerde omgang met batterijen kan resulteren in brand, explosies, weglekken van gevaarlijke stoffen en andere gevaarlijke situaties!

-  Laat batterijen nooit in kinderhanden terechtkomen.
- Let erop dat niemand batterijen inslikt.
- Zoek onmiddellijk medische hulp als u of iemand anders een batterij heeft ingeslikt.
- Gebruik uitsluitend het gespecificeerde type batterij.

-  Probeer niet-oplaadbare batterijen nooit opnieuw op te laden.
- Haal oplaadbare batterijen uit het apparaat voordat u ze oplaadt.
-   Gooi batterijen nooit in het vuur of in water.
- Stel batterijen niet bloot aan hoge temperaturen en direct zonlicht.
-   Maak batterijen nooit open en vervorm ze nooit.
-  Sluit de aansluitklemmen niet kort.

- Haal lege batterijen uit het apparaat en voer ze op veilige wijze af.
-  Gebruik geen verschillende batterijtypen of nieuwe en gebruikte batterijen samen.
-  Plaats batterijen altijd met de juiste stand van de polen in het apparaat.
- Haal de batterijen uit het apparaat als u het langere tijd niet gebruikt.

- Controleer de batterijen regelmatig. Lekkende batterijen kunnen letsel tot gevolg hebben en schade aan het apparaat veroorzaken.
- Gebruik veiligheidshandschoenen bij lekkende batterijen! Reinig de contacten van de batterijen en het apparaat en het batterijvak met een droge doek.
Voorkom contact van huid en slijmvliezen, in het bijzonder de ogen, met de chemicaliën. Bij contact spoelt u de chemicaliën er met veel water af en zoekt u onmiddellijk medische hulp.

6. Apparaatbeschrijving

(afbeeldingen: zie uitvouwpagina)

Afbeelding A:

- 1 Display
- 2 Inschakel-/functietoets 
- 3 Vingeropening
- 4 Klepje batterijvak (aan de achterzijde)
- 5 Oogje voor draagband

Afbeelding B:

- 6 Indicatie batterijtoestand 
- 7 Polsfrequentie (hartslagen per minuut) PR bpm
- 8 Hartslagkolom
- 9 Polsgolf (plethysmografische golf)
- 10 Perfusie-index **PI** %
- 11 Arteriële zuurstofverzadiging van de hemoglobine %**SpO₂**

Afbeelding C:

- 12 Batterijen

Afbeelding D:

- 13 Draagband

7. Ingebruikname

- 1) Haal alle delen van het apparaat en de gebruiksaanwijzing uit de verpakking.
- 2) Verwijder alle verpakkingsmaterialen en eventuele folie en stickers van het apparaat.

7.1. Batterijen plaatsen/vervangen

Opmerking

- Plaats uitsluitend 2 alkalinebatterijen van het type AAA (LR03) in het batterijvak.
 - 1) Schuif het klepje van het batterijvak  naar buiten.
 - 2) Als de lege batterijen nog in het batterijvak zitten, verwijdert u ze.
 - 3) Plaats 2 nieuwe batterijen met de positie van de polen zoals aangegeven in het batterijvak.
 - 4) Schuif het klepje van het batterijvak  weer zo terug dat het vastklikt.

Opmerking

- ▶ Wanneer de batterijen bijna leeg zijn, verschijnt op het display **1** de tekst "LowPower" en gaat het apparaat uit. Vervang de batterijen dan meteen.

7.2. Draagband installeren

- 1) Trek het dunne deel van de draagband **13** door het oogje voor de draagband **5**.
- 2) Leid het dikkere deel van de draagband **13** door de lus (zie afb. D).

7.3. Meting uitvoeren

- 1) Schuif een vinger in de vingeropening **3**.
- 2) Druk meermaals op de inschakel-/functietoets  **2**, tot de indicatie B (zie uitvouwpagina) verschijnt.
- 3) Wacht even tot de meetwaarden op het display **1** verschijnen.

Opmerking

- ▶ Als er geen vinger in de vingeropening **3** is gestoken, verschijnt "Finger out" onder op het display **1** en gaat het apparaat uit.
- ▶ Het apparaat wordt na een periode van inactiviteit automatisch uitgeschakeld.

7.4. Meetwaarden beoordelen

 **WAARSCHUWING!** De onderstaande waarden zijn niet van toepassing op mensen met reeds bestaande aandoeningen, zoals hartfalen, astma en bij een verblijf op hoogtes boven 1500 meter. Als u lijdt aan een reeds bestaande aandoening, bespreek de waarden dan altijd met uw arts.

Meetresultaat SpO ₂ in %	Inschatting/te treffen maatregelen
99-94	Normaal bereik
93-90	Laag bereik: raadpleging van een arts aanbevolen

Meetresultaat SpO ₂ in %	Inschatting/te treffen maatregelen
<90	Kritisch bereik: raadpleeg dringend een arts!
Bron: gebaseerd op "Windisch W et al. S2k-Leitlinie: Nichtinvasive und invasive Beatmung als Therapie der chronischen respiratorischen Insuffizienz – Revision 2017; Pneumologie 2017; 71: 722-795"	

Hoogte-afhankelijke daling van de zuurstofverzadiging

i Opmerking

- De volgende tabel toont de verschillende effecten van verschillende hoogtes op de zuurstofverzadigingswaarde en het menselijk organisme. De onderstaande waarden gelden ook niet voor mensen met reeds bestaande aandoeningen zoals hartfalen, astma en andere aandoeningen van de luchtwegen. In het geval van reeds bestaande aandoeningen kunnen ziekteverschijnselen al optreden op lagere hoogtes.

Hoogteniveaus	Te verwachten SpO ₂ -waarde in %	Gevolgen voor de mens
1500-2500 m	> 90	Geen hoogteziekte (in de regel)
2500-3000 m	~ 90	Hoogteziekte, aanpassing aanbevolen
Bron: Hackett PH, Roach RC: High-Altitude Medicine. In: Auerbach PS (ed): Wilderness Medicine, 3rd edition; Mosby, St. Louis, MO 1995; 1-37.		

7.5. Instellingen uitvoeren

- Druk, als het apparaat is ingeschakeld, opnieuw op de inschakel-/functietoets  ② om te wisselen tussen verschillende display-indicaties.
- Houd, als het apparaat is ingeschakeld, de inschakel-/functietoets  ② ingedrukt om het instellingsmenu op te roepen.

Druk opnieuw op de inschakel-/functietoets  2 om te wisselen tussen de menuopties. Houd de inschakel-/functietoets  2 ingedrukt om de gemarkeerde "*" menuoptie te wijzigen:

- "Alm": wanneer deze functie op "on" staat, klinkt er een geluidssignaal tijdens de metingen.
- "Pulse Beep": wanneer deze functie op "on" staat, klinkt er een alarmsignaal bij de ingestelde hartslagfrequentie.
- "SpO₂ lo": hier kan een minimumwaarde voor de zuurstofverzadiging worden ingesteld waarbij het alarmsignaal klinkt.
- "PR Hi": hier kan een maximumwaarde voor de polsfrequentie worden ingesteld waarbij het alarmsignaal klinkt.
- "PR Lo": hier kan een minimumwaarde voor de polsfrequentie worden ingesteld waarbij het alarmsignaal klinkt.
- "Restore": hier kunnen de fabrieksinstellingen worden hersteld.

- “+/-”: hier kan worden ingesteld of de instellingswaarden moeten worden verhoogd of verlaagd.
- “Exit”: hier kunt u het instellingsmenu verlaten en teruggaan naar de meetmodus.

8. Reinigen



GEVAAR!

- Dompel het apparaat nooit onder in water of andere vloeistoffen!



LET OP!

- Gebruik geen schurende of bijtende schoonmaakmiddelen of oplosmiddelen. Deze kunnen het oppervlak aantasten en het apparaat onherstelbaar beschadigen.
- Veeg het apparaat zo nodig af met een vochtige doek.

9. Opbergen

- Haal de batterijen uit het apparaat wanneer u het langere tijd niet gebruikt.
- Berg het apparaat op een stofvrije en droge plaats op. Neem de opslag- en transportomstandigheden in acht (zie **11. Technische gegevens**).

10. Afvoeren



Het symbool met een doorstreepte vuilnisbak betekent dat dit apparaat aan het einde van zijn levensduur niet met het normale huisvuil meegegeven mag worden. Het apparaat moet worden ingeleverd bij speciaal hiervoor bestemde inzamelpunten, milieustraten of afvalverwerkingsbedrijven.

Verwijder alle persoonlijke gegevens voordat u het product inlevert.

Breng batterijen of accu's die niet in het oude apparaat zitten, en lampen die kunnen worden verwijderd zonder ze te vernietigen, naar een apart inzamelpunt.

Bij vast ingebouwde accu's moet er bij het afvoeren op worden gewezen dat het product een accu bevat.

De verpakking bestaat uit milieuvriendelijke materialen, die u via de plaatselijke recyclepunten kunt afvoeren.

Voer de verpakking af volgens de milieuvoorschriften.

10.1. Batterijen/accu's afvoeren



Batterijen/accu's moeten als gevaarlijk afval worden behandeld en moeten daarom worden ingeleverd bij een bevoegde organisatie (winkel, vakhandel, openbaar afvalpunt, commercieel afvalverwerkingsbedrijf). Batterijen/accu's kunnen giftige zware metalen bevatten.

De zware metalen worden aangeduid met letters onder het symbool: Cd = cadmium, Hg = kwik, Pb = lood.

Deponeer batterijen/accu's daarom niet bij het huisvuil, maar lever ze gescheiden in. Lever batterijen/accu's uitsluitend in ontladen toestand in.

11. Technische gegevens

Apparaatnaam, model	SPO 3 A1
Meetmethode	Niet-invasieve meting van de arteriële zuurstofverzadiging van hemoglobine en de hartslag op de vinger
Meetbereik	SpO ₂ : 35~100% Hartslag 30~250 slagen/min.
Nauwkeurigheid	SpO ₂ : 80%~100%: $\pm 2\%$; Hartslag 30-250 ± 2 slagen/min.
Max. meetafwijking van de hartslagindicatie	SpO ₂ : 1% Hartslagfrequentie 1 slag/min.

Gebruiksomstandigheden	+10 °C tot +40 °C omgevingstemperatuur ≤ 75% relatieve luchtvochtigheid (niet-condenserend) 700-1060 hPA luchtdruk
Transport-/opslagomstandigheden	-40 °C tot +60 °C omgevingstemperatuur ≤ 95% relatieve luchtvochtigheid (niet-condenserend) 500-1060 hPA luchtdruk
Voeding	2 x 1,5 V  AAA-batterijen (LR03)
Levensduur batterijen	Met 2 AAA-batterijen kan het apparaat ongeveer 2 jaar worden gebruikt bij 3 metingen per dag (elk 60 seconden).
Afmetingen (l x b x h)	63,7 x 35 x 35 mm
Gewicht	ca. 60 g (incl. batterijen)
Classificatie	IP22

Informatie over elektromagnetische compatibiliteit

- Het apparaat is geschikt voor gebruik in alle omgevingen die zijn aangegeven in deze gebruiksaanwijzing, inclusief een thuisomgeving.

WAARSCHUWING!

- Dit apparaat voldoet aan de norm EN 60601-1-2 en is onderworpen aan speciale voorzorgsmaatregelen met betrekking tot elektromagnetische compatibiliteit. Houd er rekening mee dat draagbare en mobiele HF-communicatieapparaten (inclusief randapparatuur zoals antennekabels en externe antennes) invloed kunnen hebben op de werking van dit apparaat. Vermijd bij gebruik sterke elektromagnetische storingen, bijv. in de buurt van mobiele telefoons, magnetrons e.d. Houd de pulsoximeter op een afstand van minstens 30 cm van dergelijke apparaten.
- Het gebruik van dit apparaat direct naast of samen met andere apparaten moet worden vermeden, omdat dit kan leiden tot een incorrecte werking.

Wanneer dergelijk gebruik noodzakelijk is, moeten het apparaat en de andere apparaten worden geobserveerd om er zeker van te zijn dat ze correct werken.

- Het gebruik van accessoires, omvormers en kabels die niet door de fabrikant zijn gespecificeerd of geleverd, kan leiden tot verhoogde elektromagnetische emissies of een verminderde elektromagnetische storingsbestendigheid van het apparaat. Dit kan resulteren in een incorrecte werking.
- Als dit niet in acht wordt genomen, kunnen de prestaties van het apparaat afnemen.
- Dit apparaat mag niet worden gebruikt in een MRI-omgeving.
- Het apparaat is mogelijk slechts beperkt bruikbaar bij aanwezigheid van elektromagnetische interferentie. Als gevolg hiervan kunnen er bijvoorbeeld foutmeldingen of een storing van het display/apparaat optreden.

Richtlijnen en normen

■ Het apparaat voldoet aan de volgende normen, wetgeving en verordeningen:

- EU-verordening betreffende medische hulpmiddelen MDR (EU) 2017/745
- **RoHS-richtlijn** (2011/65/EU)*

* De volledige verantwoordelijkheid voor het uitreiken van deze conformiteitsverklaring ligt bij de fabrikant. Het hierboven beschreven object van de verklaring voldoet aan de voorschriften van de Richtlijn 2011/65/EU van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2011 aangaande de beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparaten.

- EN 60601-1
- EN 60601-1-2
- EN 60601-1-11

- DIN EN ISO 80601-2-61
- IEC 62471
- EN 60601-1-6
- EN 62366-1
- EN 62304

Melding van ongewenste gebeurtenissen voor gebruikers/ patiënten in EU-landen

Wanneer gebruikers/patiënten van mening zijn dat zich bij hen een ernstig voorval met betrekking tot het product heeft voorgedaan, worden deze verzocht het voorval te melden aan de fabrikant en/of diens gevolmachtigde, en ook aan de verantwoordelijke instanties in de lidstaat waarin de gebruiker/patiënt zich bevindt.

12. Garantie van Kompernaß Handels GmbH

Geachte klant,

U hebt op dit apparaat 3 jaar garantie vanaf de aankoopdatum. In geval van gebreken in dit product hebt u wettelijke rechten tegenover de verkoper van het product. Deze wettelijke rechten worden door onze hierna beschreven garantie niet beperkt.

Garantievoorwaarden

De garantieperiode geldt vanaf de datum van aankoop. Bewaar de kassabon zorgvuldig. U hebt hem nodig als bewijs van aankoop.

Als er binnen drie jaar vanaf de aankoopdatum van dit product een materiaal- of fabricagefout optreedt, wordt - naar onze keuze - het product door ons kosteloos gerepareerd of vervangen of wordt de koopprijs terugbetaald. Voorwaarde voor deze garantie is dat het defecte apparaat en het aankoopbewijs (kassabon) binnen de termijn van drie jaar worden overlegd en dat kort wordt omschreven waaruit het gebrek bestaat en wanneer het is opgetreden.

Wanneer het defect door onze garantie wordt gedekt, krijgt u het gerepareerde product of een nieuw product retour. Met de reparatie of vervanging van het product begint er geen nieuwe garantieperiode.

Garantieperiode en wettelijke aanspraken bij gebreken

De garantieperiode wordt door deze waarborg niet verlengd. Dat geldt ook voor vervangen en gerepareerde onderdelen. Eventueel al bij aankoop aanwezige schade en gebreken moeten meteen na het uitpakken worden gemeld. Voor reparaties na afloop van de garantieperiode worden kosten in rekening gebracht.

Garantieomvang

Het apparaat is op basis van strenge kwaliteitsnormen met de grootst mogelijke zorg vervaardigd en voorafgaand aan de levering nauwkeurig gecontroleerd.

De garantie geldt voor materiaal- of fabricagefouten. Deze garantie geldt niet voor productonderdelen die onderhevig zijn aan normale slijtage en die daarom als slijtonderdelen

worden beschouwd, of voor schade aan breekbare onderdelen zoals schakelaars of onderdelen die van glas zijn gemaakt.

Deze garantie vervalt wanneer het product is beschadigd, ondeskundig is gebruikt of is gerepareerd. Voor deskundig gebruik van het product moeten alle in de gebruiksaanwijzing beschreven aanwijzingen precies worden opgevolgd. Gebruiksdoeleinden en handelingen die in de gebruiksaanwijzing worden afgeraden of waarvoor wordt gewaarschuwd, moeten beslist worden vermeden.

Het product is uitsluitend bestemd voor privégebruik en niet voor bedrijfsmatige doeleinden. Bij verkeerd gebruik en ondeskundige behandeling, bij gebruik van geweld en bij reparaties die niet door ons erkend servicefiliaal zijn uitgevoerd, vervalt de garantie.

Afhandeling bij een garantiekwestie

Voor een snelle afhandeling van uw aanvraag neemt u de volgende aanwijzingen in acht:

- Houd voor alle aanvragen de kassabon en het artikelnummer (IAN) 518645_2504 als aankoopbewijs bij de hand.

- Het artikelnummer vindt u op het typeplaatje van het product, op het product gegraveerd, op de titelpagina van de gebruiksaanwijzing (linksonder) of op de sticker op de achter- of onderkant van het product.
- Als er fouten in de werking of andere gebreken optreden, neemt u eerst contact op met de hierna genoemde serviceafdeling, **telefonisch** of **via e-mail**.
- Een als defect geregistreerd product kunt u dan zonder portokosten naar het aan u doorgegeven serviceadres sturen. Voeg het aankoopbewijs (kassabon) bij en vermeld waaruit het gebrek bestaat en wanneer het is opgetreden.



Op www.lidl-service.com kunt u deze en vele andere handleidingen, productvideo's en installatiesoftware downloaden.

Met deze QR-code gaat u direct naar de website van Lidl Service (www.lidl-service.com) en kunt u met het invoeren van het artikelnummer (IAN) 518645_2504 de gebruiksaanwijzing openen.

12.1. Service

NL

Service Nederland

Tel.: 0800 0249630

E-Mail: kompernass@lidl.nl

BE

Service België

Tel.: 0800 12089

E-Mail: kompernass@lidl.be

IAN 518645_2504

12.2. Importeur

Let op: het volgende adres is geen serviceadres. Neem eerst contact op met het opgegeven serviceadres.

Voor de EU-markt



KOMPERNASS HANDELS GMBH
BURGSTRASSE 21
44867 BOCHUM
DUITSLAND
www.kompernass.com

Voor de Britse markt

Lidl Great Britain Ltd
Lidl House 14 Kingston Road
Surbiton
KT5 9NU

Indice

1. Introduzione	201
2. Uso conforme	201
2.1. Controindicazioni	202
3. Materiale in dotazione	203
4. Avvertenze e simboli utilizzati	203
5. Avvertenze di sicurezza	211
5.1. Avvertenze di sicurezza relative all'uso delle pile.	219
6. Descrizione dell'apparecchio	223
7. Messa in funzione	224
7.1. Inserimento/sostituzione delle pile	225
7.2. Montaggio del laccio di sostegno	226

7.3. Svolgimento della misurazione	226
7.4. Valutazione dei valori misurati	227
7.5. Impostazioni	229
8. Pulizia	231
9. Conservazione	232
10. Smaltimento	232
10.1. Smaltimento delle pile	233
11. Dati tecnici	234
12. Garanzia della Kompernass Handels GmbH	240
12.1. Assistenza	245
12.2. Importatore	246

1. Introduzione

Congratulazioni per l'acquisto del nuovo apparecchio.

È stato scelto un prodotto di alta qualità. Il manuale di istruzioni è parte integrante del presente prodotto. Esso contiene importanti note sulla sicurezza, sull'uso e sullo smaltimento. Prima di utilizzare il prodotto, acquisire dimestichezza con tutte le note relative all'uso e alla sicurezza. Utilizzare il prodotto solo come descritto e per i campi d'impiego indicati. Conservare sempre le istruzioni per l'uso nelle vicinanze del prodotto in modo da poterle consultare all'occorrenza. In caso di cessione del prodotto a terzi, consegnare anche tutta la relativa documentazione.

2. Uso conforme

Questo apparecchio è indicato per la misurazione non invasiva della saturazione ossiemoglobinica arteriosa e della frequenza del battito sul dito di persone adulte. La saturazione di ossigeno è un indicatore importante per la valutazione della funzione respiratoria.

Una bassa saturazione di ossigeno può essere indizio di una patologia come l'asma o l'insufficienza cardiaca. In tal caso, rivolgersi senza indugio a un medico!

Questo apparecchio non è adatto all'utilizzo su neonati e bambini piccoli né su persone con gravi aritmie.

L'apparecchio è indicato per l'automisurazione. Non sono richieste particolari conoscenze tecniche, il paziente può usare da sé l'apparecchio.

Questo apparecchio è destinato esclusivamente all'uso in ambienti domestici. Non utilizzare l'apparecchio a fini commerciali o industriali.

2.1. Controindicazioni

In stato di gravidanza si raccomanda l'utilizzo solo previo consulto medico. I pazienti affetti da preeclampsia non devono usare l'apparecchio.

L'apparecchio non è indicato per pazienti con dispositivi elettrici impiantati come pace-maker o defibrillatori. Non utilizzare l'apparecchio se si indossano impianti di metallo.

3. Materiale in dotazione

Il materiale in dotazione comprende i seguenti componenti:

- pulsossimetro
- due pile alcaline micro AAA (LR03)
- laccio di sostegno
- manuale di istruzioni

4. Avvertenze e simboli utilizzati

Nel presente manuale di istruzioni, sulla confezione e sull'apparecchio vengono utilizzati gli avvisi e i simboli seguenti (se pertinenti):



PERICOLO! Un avviso con questo simbolo e la parola di segnalazione "PERICOLO" indica una situazione di pericolo immediata che, se non viene evitata, ha come conseguenza la morte o una lesione grave.



AVVERTENZA! Un avviso con questo simbolo e la parola di segnalazione "AVVERTENZA" indica una possibile situazione di pericolo che, se non viene evitata, potrebbe avere come conseguenza la morte o una lesione grave.



CAUTELA! Un avviso con questo simbolo e la parola di segnalazione "CAUTELA" indica una possibile situazione di pericolo che, se non viene evitata, potrebbe avere come conseguenza una lesione di entità lieve o moderata.



ATTENZIONE! Un avviso con questo simbolo e la parola di segnalazione "ATTENZIONE" indica una possibile situazione che, se non viene evitata, potrebbe avere come conseguenza danni materiali.



Nota: una nota fornisce ulteriori informazioni volte a facilitare l'uso dell'apparecchio.

	Attenersi alle istruzioni! Prima di iniziare il lavoro e/o di usare apparecchi o macchine, leggere le istruzioni.
	Corrente/tensione continua
	Dispositivo medico
	Importatore
	Tipo BF: l'apparecchio è stato sviluppato in modo da proteggere il paziente dalla scarica elettrica.
IP22	Protezione contro corpi estranei $\geq 12,5$ mm e contro il gocciolamento inclinato d'acqua

%SpO₂	Saturazione ossiemoglobinica arteriosa (in percentuale)
PR bpm	Frequenza del battito (pulsazioni al minuto)
PI %	L'indice di perfusione (PI) è il rapporto tra il flusso sanguigno pulsatile e il flusso sanguigno non pulsatile nel tessuto periferico del paziente.
	Indicatore del livello di carica delle pile
	Anno/mese di produzione
	Unique Device Identifier: codice per l'identificazione univoca del prodotto
	Numero di serie

	Codice articolo
	Codice tipo
	Intervallo di temperatura
	Intervallo di umidità
	Intervallo di pressione dell'aria

	Non smaltire l'apparecchio elettrico insieme ai rifiuti domestici!
	Smaltire l'imballaggio in modo ecocompatibile.
	Utilizzare entro
	Imballaggio in materiali riciclabili. Per la differenziazione dei rifiuti tenere conto dell'identificazione dei materiali di imballaggio: presentano codici costituiti da abbreviazioni (a) e numeri (b) con il seguente significato: 1-7: materie plastiche, 20-22: carta e cartone, 80-98: materiali compositi.

  ES/PT	L'imballaggio contiene elementi di carta e/o cartone. L'imballaggio contiene elementi di plastica e/o metallo.
	Questo prodotto soddisfa tutti i requisiti delle vigenti direttive europee e nazionali.
	Questo carattere conferma che il prodotto è conforme ai requisiti vigenti in Gran Bretagna in termini di sicurezza dei prodotti.



Indirizzo del produttore: Shenzhen BSX Technology Electronics Co., Ltd.
Rm101,2/F~4/F, Building no.13, Ailian Industrial Park, Wulian Community, Longgang District, Shenzhen 518116 Guangdong, P.R. China



Rappresentante autorizzato nella Comunità Europea/Unione Europea:
MedNet EC-REP GmbH, Borkstrasse 10, 48163 Münster, Germany



FR

Cet appareil,
ses accessoires
et piles
se recyclent

À DÉPOSER
EN MAGASIN



OU

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



FR



FR



FR: il prodotto, la confezione e il manuale di istruzioni sono riciclabili, sono soggetti ad una responsabilità estesa del produttore e vanno differenziati.

5. Avvertenze di sicurezza

AVVERTENZA!

- Questo apparecchio non è indicato per l'uso da parte di persone (inclusi bambini) con limitate capacità fisiche, sensoriali o mentali o prive dell'esperienza e/o della conoscenza necessaria, a meno che tali persone non vengano sorvegliate da un responsabile per la sicurezza o non abbiano ricevuto indicazioni sull'impiego dell'apparecchio.
- Sorvegliare i bambini per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.

- Non utilizzare l'apparecchio se si indossano impianti elettrici (ad es. pacemaker).
- Non utilizzare l'apparecchio se si indossano impianti di metallo.
- Non utilizzare l'apparecchio su neonati, bambini o animali domestici.
- Non utilizzare l'apparecchio se si hanno reazioni allergiche ai prodotti in gomma.
- Non utilizzare l'apparecchio se esso o il dito interessato dall'applicazione sono umidi.

- Non utilizzare l'apparecchio mentre si sta misurando la pressione sanguigna sul lato del braccio in cui è applicato il bracciale.
- Non utilizzare l'apparecchio su dita con smalto per unghie, sporcizia o cerotti.
- Non utilizzare l'apparecchio su dita molto grosse che non possono essere inserite senza sforzo nell'apparecchio. Non utilizzarlo neanche su dita troppo piccole.
- Non utilizzare l'apparecchio su dita che presentano alterazioni anatomiche, edemi, cicatrici, smalto per unghie, unghie artificiali, altri cosmetici o ustioni.

- Non utilizzare l'apparecchio su pazienti irrequieti nel punto di applicazione (ad es. tremore).
- Non utilizzare l'apparecchio per oltre due ore sullo stesso dito.
- Durante il funzionamento, non guardare all'interno dell'alloggiamento. La luce potrebbe danneggiare gli occhi.
- Non utilizzare l'apparecchio vicino a sorgenti luminose intense.
- I valori misurati da sé fungono solo da autocontrollo, non sostituiscono una visita medica! Parlare dei propri valori con il medico.

Non usarli in alcun caso come base per prendere decisioni di tipo medico (assunzione di farmaci e loro dosaggio)!

- Eventuali patologie cardiovascolari possono portare a misurazioni errate o limitare la precisione della misurazione. Ciò vale anche in caso di pressione sanguigna molto bassa, diabete, disturbi circolatori, aritmie, brividi di freddo e tremori.
- L'indicazione dei valori misurati non permette una diagnosi sicura del battito e serve unicamente a rappresentare la variazione ottica attuale del segnale nel punto di misurazione.

- Non svolgere un'autodiagnosi né eseguire un trattamento in proprio basandosi sui risultati della misurazione senza aver consultato il medico curante. In particolare, non cambiare il tipo e/o il dosaggio di un'eventuale cura farmacologica né ricorrere a cure farmacologiche proprie.
- L'apparecchio può indicare solo un valore di misura momentaneo e non può essere utilizzato per una sorveglianza continua.

❗ **ATTENZIONE!**

- Utilizzare solo accessori compresi nel materiale in dotazione o consigliati dal produttore.
- Proteggere l'apparecchio da umidità, polvere, temperature elevate ed esposizione ai raggi solari diretti.
- Se l'apparecchio è stato conservato a temperatura vicina ai valori limite per le condizioni di trasporto e stoccaggio e viene portato in un ambiente a 20 °C, prima dell'uso attendere circa due ore per riportarlo alla temperatura ambiente.

- Non è consentito aprire, disassemblare o riparare l'alloggiamento dell'apparecchio. Inoltre, non è garantita la sicurezza e la garanzia decade.
- Non far cadere l'apparecchio e non esporlo a forti scosse.
- L'apparecchio contiene componenti elettronici sensibili; pertanto, evitare l'uso diretto in ambienti con forte campo elettromagnetico (ad es. telefoni cellulari, microonde ecc.) perché ciò potrebbe causare risultati inesatti.

5.1. Avvertenze di sicurezza relative all'uso delle pile

⚠ AVVERTENZA! L'uso errato delle pile potrebbe causare incendi, esplosioni, fuoriuscite di sostanze pericolose o altre situazioni pericolose!

-  Non permettere mai che le pile giungano nelle mani dei bambini.
- Assicurarsi che nessuno ingerisca le pile.
- In caso di ingestione di una pila, richiedere immediatamente assistenza medica.
- Utilizzare esclusivamente il tipo di pile indicato.

-  Non ricaricare mai le pile non ricaricabili.
- Prima di caricare le pile, rimuoverle dall'apparecchio.
-   Non gettare mai le pile nel fuoco o in acqua.
- Non sottoporre le pile a temperature elevate e all'irradiazione solare diretta.
-   Non aprire né deformare mai le pile.
-  Non cortocircuitare i morsetti di collegamento.

- Rimuovere le pile scariche dall'apparecchio e smaltirle in sicurezza.
-  Non usare insieme pile di tipo diverso o pile nuove e usate.
-  Inserire le pile nell'apparecchio sempre con la polarità corretta.
- Se non si utilizza l'apparecchio per lungo tempo, rimuovere le pile.
- Controllare periodicamente le pile. Le pile che perdono liquido possono causare lesioni e danni all'apparecchio.

- In presenza di fuoriuscita di acidi dalle pile, utilizzare guanti di protezione! Pulire i contatti delle pile e dell'apparecchio nonché il vano pile con un panno asciutto. Evitare che pelle e mucose, soprattutto quelle degli occhi, entrino in contatto con le sostanze chimiche. In caso di contatto con sostanze chimiche, sciacquare con acqua abbondante e richiedere immediatamente assistenza medica.

6. Descrizione dell'apparecchio

(per le illustrazioni, vedere la pagina pieghevole)

Figura A:

- ❶ Display
- ❷ Tasto di accensione/funzione 
- ❸ Apertura per il dito
- ❹ Coperchio del vano pile (sul lato posteriore)
- ❺ Occhiello per il laccio di sostegno

Figura B:

- ❻ Indicazione del livello di carica della batteria 
- ❼ Frequenza del battito (pulsazioni al minuto) PR bpm
- ❽ Colonna del battito

- 9 Onda del battito (onda pletismografica)
- 10 Indice di perfusione **PI** %
- 11 Saturazione ossiemoglobinica arteriosa %**SpO₂**

Figura C:

- 12 Pile

Figura D:

- 13 Laccio di sostegno

7. Messa in funzione

- 1) Prelevare tutti i componenti dell'apparecchio e il manuale di istruzioni dalla confezione.
- 2) Rimuovere tutto il materiale di imballaggio ed eventuali pellicole e adesivi.

7.1. Inserimento/sostituzione delle pile

i Nota

► Inserire nel vano pile sempre e soltanto due pile alcaline di tipo AAA (LR03).

- 1) Spingere il coperchio del vano pile ❹ verso l'esterno.
- 2) Se inserite, rimuovere le pile scariche.
- 3) Inserire le due pile nuove rispettando la polarità riportata nel vano.
- 4) Spingere il coperchio del vano pile ❹ in modo che si inserisca a scatto.

i Nota

► Se le pile sono quasi scariche, sul display ❶ compare la scritta "LowPower" e l'apparecchio si spegne. Sostituire le pile al più presto.

7.2. Montaggio del laccio di sostegno

- 1) Tirare la parte sottile del laccio di sostegno ❸ attraverso l'occhiello per il laccio di sostegno ❺.
- 2) Far passare la parte spessa del laccio di sostegno ❸ attraverso il cappio (v. figura D).

7.3. Svolgimento della misurazione

- 1) Inserire un dito nell'apertura per il dito ❸.
- 2) Premere ripetutamente il tasto di accensione/funzione  ❷ finché sul lato ribaltabile non compare l'indicazione B).
- 3) Attendere un momento finché sul display ❶ non compaiono i valori di misura.

Nota

- Se nell'apertura per il dito ❸ non è stato inserito un dito, compare "Finger out" in basso nel display ❶ e l'apparecchio si spegne.

- L'apparecchio si spegne automaticamente dopo un certo tempo di inattività.

7.4. Valutazione dei valori misurati

⚠ AVVERTENZA! I valori riportati di seguito non si applicano a persone con patologie prelie quali insufficienza cardiaca e asma né in caso di sosta ad altitudini superiori ai 1500 m. Se si è affetti da patologie prelie, discutere sempre i valori con il proprio medico.

Risultato della misurazione SpO ₂ in %	Classificazione/misure da adottare
99-94	Intervallo normale
93-90	Intervallo basso: si consiglia una visita medica
<90	Intervallo critico: rivolgersi urgentemente a un medico!

Risultato della misurazione SpO₂ in %	Classificazione/misure da adottare
Fonte: con riferimento a "Windisch W et al. S2k-Leitlinie: Nichtinvasive und invasive Beatmung als Therapie der chronischen respiratorischen Insuffizienz – Revision 2017; Pneumologie 2017; 71: 722-795"	

Riduzione della saturazione dell'ossigeno a causa dell'altitudine

i Nota

- Dalla tabella che segue si possono ricavare i diversi effetti di varie altitudini sul valore di saturazione dell'ossigeno e sull'organismo umano. Anche in questo caso, i valori riportati di seguito non si applicano a persone con patologie prelie quali insufficienza cardiaca, asma e altre patologie delle vie respiratorie. In presenza di patologie prelie, i sintomi della malattia possono presentarsi già a basse altitudini.

Altitudini	Valore SpO ₂ previsto in %	Conseguenze per la persona
1500--2500 m	> 90	Nessun mal d'altitudine (di norma)
2500-3000 m	~ 90	Mal d'altitudine, si consiglia un adattamento
Fonte: Hackett PH, Roach RC: High-Altitude Medicine. In: Auerbach PS (ed): Wilderness Medicine, 3rd edition; Mosby, St. Louis, MO 1995; 1-37.		

7.5. Impostazioni

- Ad apparecchio acceso, premere nuovamente il tasto di accensione/funzione  ② per alternare tra le diverse indicazioni del display.
- Quando l'apparecchio è acceso, mantenere premuto il tasto di accensione/funzione  ② per accedere al menu delle impostazioni. Premere nuovamente il tasto di accensione/funzione  ② per alternare tra le voci del menu.

Mantenere premuto il tasto di accensione/funzione  2 per cambiare la voce di menu contrassegnata "*":

- "Alm": se questa funzione è impostata su "on", durante le misurazioni viene emesso un suono.
- "Pulse Beep": se questa funzione è impostata su "on", con il battito cardiaco impostato viene emesso un allarme acustico.
- "SpO₂ lo": qui si può impostare un valore minimo di saturazione dell'ossigeno in corrispondenza del quale viene emesso l'allarme acustico.
- "PR Hi": qui si può impostare un valore massimo di frequenza del battito in corrispondenza del quale viene emesso l'allarme acustico.
- "PR Lo": qui si può impostare un valore minimo di frequenza del battito in corrispondenza del quale viene emesso l'allarme acustico.
- "Restore": qui si possono ripristinare le impostazioni di fabbrica.

- "+/-": qui si può impostare l'aumento o la riduzione dei valori di impostazione.
- "Exit": qui si può uscire dal menu delle impostazioni e ritornare alla modalità di misurazione.

8. Pulizia



PERICOLO!

- Non immergere mai l'apparecchio in acqua o altri liquidi!



ATTENZIONE!

- Non utilizzare detergenti o solventi abrasivi o corrosivi. Essi possono attaccare la superficie e danneggiare irreparabilmente l'apparecchio.
- Se necessario, pulire l'apparecchio con un panno umido.

9. Conservazione

- Se non si utilizza l'apparecchio per lungo tempo, rimuovere le pile.
- Conservare l'apparecchio in un luogo asciutto e privo di polvere. Rispettare le condizioni di stoccaggio e trasporto (vedere **11. Dati tecnici**).

10. Smaltimento



Il simbolo del cassonetto dei rifiuti barrato significa che questo apparecchio non deve essere smaltito con i normali rifiuti domestici al termine della sua durata utile. L'apparecchio deve essere conferito a punti di raccolta autorizzati, centri di riciclaggio o aziende di smaltimento.

Si prega di eliminare tutti i dati personali prima della riconsegna.

Prima della riconsegna rimuovere le pile o batterie non integrate nell'apparecchio vecchio, nonché le luci che sia possibile togliere senza distruggerle, e conferirle ad un punto di raccolta separato.

In caso di batterie fisse, all'atto dello smaltimento fare presente che questo apparecchio contiene una batteria.

L'imballaggio è costituito da materiali ecocompatibili che possono essere smaltiti tramite gli appositi centri di raccolta e riciclaggio.

Smaltire l'imballaggio conformemente alle norme di tutela ambientale.

10.1. Smaltimento delle pile



Le pile/batterie vanno trattate come rifiuti speciali e devono essere smaltite nel rispetto dell'ambiente attraverso i punti di raccolta competenti (rivenditori, negozi specializzati, enti pubblici comunali, aziende di smaltimento professionali). Le pile/batterie possono contenere metalli pesanti tossici.

I metalli pesanti contenuti sono indicati con lettere sotto il simbolo: Cd = cadmio, Hg = mercurio, Pb = piombo.

Pertanto non smaltire le pile/batterie assieme ai normali rifiuti domestici, bensì conferirle ad una raccolta differenziata.

Restituire le pile/batterie solo se scariche.

11. Dati tecnici

Nome apparecchio, modello	SPO 3 A1
Metodo di misurazione	misurazione non invasiva della saturazione ossiemoglobinica arteriosa e della frequenza del battito sul dito
Campo di misura	SpO ₂ : 35~100% polso 30~250 battiti/min.
Precisione	SpO ₂ : 80%~100%: $\pm 2\%$; polso 30-250 ± 2 battiti/min.

Scostamento massimo della frequenza cardiaca	SpO ₂ : 1% battito cardiaco 1 battito/min.
Condizioni di funzionamento	Temperatura ambiente da +10 °C a +40 °C ≤75% di umidità atmosferica relativa (non condensante) Pressione dell'aria 700-1060 hPA
Condizioni di trasporto/ stoccaggio	Temperatura ambiente da -40 °C a +60 °C ≤95% di umidità atmosferica relativa (non condensante) Pressione dell'aria 500-1060 hPA
Alimentazione elettrica	Due pile  AAA (LR03) da 1,5 V
Durata utile pile	Due pile AAA permettono circa due anni di funzionamento con tre misurazioni al giorno (di 60 secondi ciascuna).
Dimensioni (l x p x a)	63,7 x 35 x 35 mm

Peso	circa 60 g (pile comprese)
Classificazione	IP22

Nota sulla compatibilità elettromagnetica

- L'apparecchio è idoneo all'uso in tutti i locali indicati nelle presenti Istruzioni per l'uso, incluso l'ambiente domestico.

AVVERTENZA!

- Questo apparecchio è conforme alla norma EN 60601-1-2 e necessita di precauzioni d'impiego particolari per quanto riguarda la compatibilità elettromagnetica. Ricordare che apparecchiature di comunicazione mobili e portatili ad alta frequenza (incluse quelle generiche come cavi di antenna e antenne esterne) possono influire sul funzionamento di questo apparecchio. Durante l'uso, evitare forti disturbi elettromagnetici come quelli generati in prossimità di telefoni cellulari, forni a microonde e simili. Mantenere almeno 30 cm di distanza tra il pulsossimetro e tali apparecchi.

- Evitare l'uso di questo apparecchio nelle immediate vicinanze di altri dispositivi oppure impilato insieme a essi, perché ciò potrebbe causarne un funzionamento scorretto. Se tale impiego dovesse essere necessario, tenere sotto osservazione l'apparecchio e gli altri dispositivi per assicurarsi che funzionino correttamente.
- L'uso di accessori, trasformatori e cavi non previsti né forniti in dotazione dal produttore può causare un aumento delle emissioni elettromagnetiche o una diminuzione della resistenza alle interferenze elettromagnetiche dell'apparecchio e, di conseguenza, causare un funzionamento scorretto.
- L'inosservanza può causare una diminuzione delle prestazioni dell'apparecchio.
- Non utilizzare questo apparecchio in un ambiente con RMT.
- In presenza di disturbi elettromagnetici, è possibile che l'apparecchio possa essere utilizzato solo in misura limitata. Di conseguenza, potrebbero presentarsi messaggi di errore o il display/l'apparecchio potrebbe guastarsi.

Direttive e norme

■ Questo apparecchio è conforme alle seguenti norme, leggi e regolamenti:

- Regolamento UE relativo ai dispositivi medici MDR (UE) 2017/745
- **Direttiva RoHS** (2011/65/EU)*

*Il produttore è il responsabile esclusivo del rilascio di questa dichiarazione di conformità. L'oggetto della dichiarazione sopra descritto soddisfa le prescrizioni della Direttiva 2011/65/EU del Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo dell'8 giugno 2011 sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.

- EN 60601-1
- EN 60601-1-2
- EN 60601-1-11

- DIN EN ISO 80601-2-61
- IEC 62471
- EN 60601-1-6
- EN 62366-1
- EN 62304

Segnalazione di eventi indesiderati per utilizzatori/pazienti in Paesi UE

Se utilizzatori/pazienti ritengono che si sia verificato un caso grave in concomitanza con l'uso del prodotto, sono invitati a segnalare tale caso al produttore e/o al suo rappresentante autorizzato e alle autorità competenti dello Stato membro in cui si trova l'utilizzatore/paziente.

12. Garanzia della Kompernass Handels GmbH

Egregio Cliente,

Questo apparecchio ha una garanzia di 3 anni dalla data di acquisto. Qualora questo prodotto presentasse vizi, Le spettano diritti legali nei confronti del venditore del prodotto. La garanzia qui di seguito descritta non costituisce alcun limite a tali diritti legali.

Condizioni di garanzia

Il periodo di garanzia decorre dalla data di acquisto. Si prega di conservare bene lo scontrino di cassa. Quest'ultimo è necessario come prova d'acquisto.

Qualora entro tre anni a partire dalla data d'acquisto del prodotto si presentasse un difetto del materiale o di fabbricazione, provvederemo a nostra discrezione a riparare o a sostituire gratuitamente il prodotto oppure a rimborsare il prezzo d'acquisto. Questa prestazione di garanzia ha come presupposto che l'apparecchio guasto e la prova d'acquisto (scontrino di cassa) vengano presentati entro il termine di tre anni e che si descriva per iscritto in cosa consiste il difetto e quando si è evidenziato.

Se il vizio rientra nell'ambito della nostra garanzia, il Suo prodotto verrà riparato o sostituito da uno nuovo. Con la riparazione o la sostituzione del prodotto non decorre un nuovo periodo di garanzia.

Periodo di garanzia e diritti legali di rivendicazione di vizi

Il periodo di garanzia non viene prolungato da interventi in garanzia. Ciò vale anche per le parti sostituite e riparate. Danni e vizi eventualmente già presenti al momento dell'acquisto devono venire segnalati immediatamente dopo che l'apparecchio è stato disimballato. Le riparazioni eseguite dopo la scadenza del periodo di garanzia sono a pagamento.

Ambito della garanzia

L'apparecchio è stato prodotto con cura secondo severe direttive qualitative e debitamente collaudato prima della consegna.

La prestazione in garanzia vale per difetti del materiale o di fabbricazione. Questa garanzia non si estende a componenti del prodotto esposti a normale logorio, che possono pertanto essere considerati come componenti soggetti a usura (esempio capacità della

batteria, calcificazione, lampade, pneumatici, filtri, spazzole...). La garanzia non si estende altresì a danni che si verificano su componenti delicati (esempio interruttori, parti realizzate in vetro, schermi, accessori vari) nonché danni derivanti dal trasporto o altri incidenti. Questa garanzia decade se il prodotto è stato danneggiato oppure utilizzato o sottoposto a interventi di manutenzione in modo non conforme. Per un utilizzo adeguato del prodotto si devono rigorosamente rispettare tutte le istruzioni esposte nel manuale di istruzioni per l'uso. Si devono assolutamente evitare modalità di utilizzo e azioni che il manuale di istruzioni per l'uso sconsiglia o da cui esso mette in guardia.

Il prodotto è destinato esclusivamente all'uso domestico e non a quello commerciale. La garanzia decade in caso di impiego improprio o manomissione, uso della forza e interventi non eseguiti dalla nostra filiale di assistenza autorizzata.

Trattamento dei casi di garanzia

Per garantire una rapida evasione della Sua richiesta, La preghiamo di seguire le seguenti istruzioni:

- Tenga a portata di mano per qualsiasi richiesta lo scontrino di cassa e il codice dell'articolo (IAN) 518645_2504 come prova di acquisto.
- Il codice dell'articolo è riportato sulla targhetta identificativa o su un'incisione presenti sul prodotto, sul frontespizio del manuale di istruzioni (in basso a sinistra) o su un adesivo applicato alla parte posteriore o inferiore del prodotto.
- Qualora si presentassero malfunzionamenti o altri tipi di vizi, contatti innanzitutto il reparto assistenza clienti qui di seguito indicato **telefonicamente** o via **e-mail**.
- Una volta che il prodotto è stato registrato come difettoso, lo può poi spedire a nostro carico, provvedendo ad allegare la prova di acquisto (scontrino di cassa), una descrizione del vizio e l'indicazione della data in cui si è presentato, all'indirizzo del servizio di assistenza clienti che Le è stato comunicato.



Sul sito www.lidl-service.com è possibile scaricare questo e molti altri manuali di istruzioni, filmati sui prodotti e software d'installazione.

Con questo codice QR si giunge direttamente al sito dell'assistenza clienti Lidl (www.lidl-service.com) e con la digitazione del codice articolo (IAN) 518645_2504 si può aprire il manuale di istruzioni di proprio interesse.

12.1. Assistenza

IT Assistenza Italia

Tel.: 800781188

E-Mail: kompernass@lidl.it

CH Assistenza Svizzera

Tel.: 0800 56 44 33

E-Mail: kompernass@lidl.ch

MT Service Malta

Tel.: 80062230

E-Mail: kompernass@lidl.com.mt

IAN 518645_2504

12.2. Importatore

Badi che il seguente indirizzo non è quello del servizio di assistenza clienti.
Contatti innanzitutto il servizio di assistenza clienti indicato.

Per il mercato europeo:



KOMPERNASS HANDELS GMBH
BURGSTRASSE 21
44867 BOCHUM
GERMANIA
www.kompernass.com

Per il mercato della GB:

Lidl Great Britain Ltd
Lidl House 14 Kingston Road
Surbiton
KT5 9NU

Índice

1. Introducción	249
2. Uso previsto	249
2.1. Contraindicaciones	250
3. Volumen de suministro	251
4. Indicaciones de advertencia y símbolos utilizados	251
5. Indicaciones de seguridad	258
5.1. Indicaciones de seguridad sobre la manipulación de las pilas	266
6. Descripción del aparato	270
7. Puesta en funcionamiento	271
7.1. Inserción/cambio de las pilas.	272
7.2. Colocación de la cinta de sujeción.	273

7.3. Realización de la medición.	273
7.4. Evaluación de los valores de medición	274
7.5. Realización de ajustes	277
8. Limpieza	278
9. Almacenamiento	279
10. Desecho	279
10.1. Desecho de las pilas/baterías	280
11. Características técnicas	281
12. Garantía de Kompernass Handels GmbH	287
12.1. Asistencia técnica	291
12.2. Importador	292

1. Introducción

Felicidades por la compra de su aparato nuevo.

Ha adquirido un producto de alta calidad. Las instrucciones de uso forman parte del producto y contienen indicaciones importantes acerca de su seguridad, uso y desecho. Antes de usar el producto, familiarícese con todas las indicaciones de manejo y de seguridad. Utilice el producto únicamente como se describe y para los ámbitos de aplicación indicados. Guarde siempre las instrucciones de uso cerca del producto para poder utilizarlas como material de consulta. Entregue todos los documentos cuando transfiera el producto a terceros.

2. Uso previsto

Este aparato está previsto para la medición no invasiva de la saturación de oxígeno de la hemoglobina en sangre arterial y la frecuencia cardíaca en el dedo de personas adultas. La saturación de oxígeno es un indicador importante para evaluar la función respiratoria.

Una saturación de oxígeno baja puede indicar una enfermedad, como asma o insuficiencia cardíaca. ¡En tal caso, busque inmediatamente asistencia médica!

Este aparato no es apto para su uso con bebés y niños pequeños ni para personas con arritmias graves.

Este aparato es apto para la automedicación. No se requieren conocimientos especializados, el paciente puede manejar el aparato de forma autónoma.

Este aparato está previsto exclusivamente para su uso doméstico privado. No lo utilice con fines comerciales o industriales.

2.1. Contraindicaciones

Durante el embarazo, recomendamos consultar a un médico antes de utilizar el aparato. Las pacientes con preeclampsia no deben utilizar el aparato.

El aparato no es apto para pacientes con dispositivos eléctricos implantados, como marcapasos o desfibriladores. No utilice el aparato si tiene implantes metálicos.

3. Volumen de suministro

El volumen de suministro consta de los siguientes componentes:

- Pulsioxímetro
- 2 pilas alcalinas Micro AAA (LR03)
- Cinta de sujeción
- Instrucciones de uso

4. Indicaciones de advertencia y símbolos utilizados

En estas instrucciones de uso, en el embalaje y en el aparato se utilizan las siguientes indicaciones de advertencia y símbolos (si corresponde):



¡PELIGRO! Una indicación de advertencia marcada con este símbolo y con el término "PELIGRO" designa una situación de peligro inminente que, si no se evita, causa lesiones mortales o graves.

	¡ADVERTENCIA! Una indicación de advertencia marcada con este símbolo y con el término "ADVERTENCIA" designa una posible situación peligrosa que, si no se evita, puede causar lesiones mortales o graves.
	¡CUIDADO! Una indicación de advertencia marcada con este símbolo y con el término "CUIDADO" designa una posible situación peligrosa que, si no se evita, puede causar lesiones de gravedad leve a moderada.
	¡ATENCIÓN! Una indicación de advertencia marcada con este símbolo y con el término "ATENCIÓN" designa una posible situación que, si no se evita, puede causar daños materiales.
	Indicación: la indicación proporciona información adicional que facilita el manejo del aparato.
	¡Observe las instrucciones de uso! Lea las instrucciones de uso antes de empezar a trabajar con aparatos o máquinas o de manejarlos.

	Corriente/tensión continua
	Producto sanitario
	Importador
	Tipo BF: el aparato está diseñado de forma que el paciente esté protegido frente a una descarga eléctrica.
IP22	Protección contra la penetración de cuerpos sólidos de $\geq 12,5$ mm y contra el goteo de agua cuando el aparato está inclinado
%SpO₂	Saturación de oxígeno de la hemoglobina en sangre arterial (porcentaje)
PR bpm	Frecuencia cardíaca (pulsaciones por minuto)

PI %	El índice de perfusión (PI, por sus siglas en inglés) es la relación entre el flujo sanguíneo pulsátil y el flujo sanguíneo no pulsátil en los tejidos periféricos del paciente.
	Indicador de carga de las pilas
	Año/mes de fabricación
	Identificador único del producto: código para la identificación inequívoca del producto
	Número de serie
	Número de artículo
	Número de modelo

	Rango de temperatura
	Rango de humedad
	Rango de presión atmosférica
	¡No deseche este aparato eléctrico con la basura doméstica!
	Deseche el embalaje de forma respetuosa con el medio ambiente.

	Fecha de caducidad
	Embalaje realizado con materiales reciclables. Observe el etiquetado de los materiales de embalaje al separar los residuos: están marcados con abreviaturas (a) y números (b) que significan lo siguiente: 1-7: plásticos, 20-22: papel y cartón, 80-98: materiales compuestos.
  ES/PT	El embalaje contiene componentes de papel y/o cartón. El embalaje contiene componentes de plástico y/o metal.

	Este producto cumple los requisitos de las normas europeas y nacionales aplicables.
	Este símbolo garantiza que el producto cumple los requisitos de seguridad aplicables en Gran Bretaña.
	Dirección del fabricante: Shenzhen BSX Technology Electronics Co., Ltd. Rm101,2/F~4/F, Building no.13, Ailian Industrial Park, Wulian Community, Longgang District, Shenzhen 518116 Guangdong, R. P. China
	Representante autorizado en la Comunidad Europea/Unión Europea: MedNet EC-REP GmbH, Borkstrasse 10, 48163 Münster, Alemania



FR
Cet appareil,
ses accessoires
et piles
se recyclent

À DÉPOSER
EN MAGASIN



OU

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



FR



+



FR



FR: Este producto, su embalaje y las instrucciones de uso son reciclables, están sujetos a una responsabilidad ampliada del fabricante y se recogen por separado.

5. Indicaciones de seguridad

⚠ ¡ADVERTENCIA!

- No permita utilizar el aparato a personas (incluidos los niños) con facultades físicas, sensoriales o mentales limitadas o que carezcan de experiencia o conocimientos a me-

nos que les vigile una persona responsable de su seguridad o hayan sido instruidas por esta en el uso del aparato.

- Vigile a los niños para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
- No utilice el aparato si tiene implantes eléctricos (p. ej., un marcapasos).
- No utilice el aparato si tiene implantes metálicos.
- No utilice el aparato con bebés, niños y mascotas.
- No utilice el aparato si tiene alergia a los productos de goma.

- No utilice el aparato si el propio aparato o el dedo que vaya a utilizar están húmedos.
- No utilice el aparato durante la medición de la presión arterial en el brazo con un brazalete.
- No utilice el aparato en dedos con las uñas pintadas, sucios o con tiritas.
- No utilice el aparato en dedos que sean demasiado gruesos y no puedan introducirse sin forzar en el aparato. Tampoco en dedos demasiado pequeños.

- No utilice el aparato en dedos con alteraciones anatómicas, edemas, cicatrices, pintura de uñas, uñas artificiales y otros cosméticos o quemaduras.
- No utilice el aparato con pacientes que no puedan mantenerse quietos en el lugar de aplicación (p. ej., con temblores).
- No utilice el aparato durante más de unas 2 horas en un dedo.
- No dirija la mirada al interior de la carcasa durante el funcionamiento. La luz podría dañarle los ojos.

- No utilice el aparato cerca de fuentes potentes de luz.
- ¡Los valores que mida solo sirven para su control personal y no sustituyen a ningún examen médico!
Consulte a un médico para hablar sobre sus valores. ¡No los utilice bajo ningún concepto como base para tomar decisiones médicas (medicamentos y dosis) por sí solo!
- Las enfermedades cardiovasculares pueden provocar errores de medición o afectar a la precisión de la medición. Esto también se aplica a los casos de presión arterial muy baja, diabetes, trastornos vasculares y arritmias cardíacas, así como escalofríos o temblores.

- La indicación de los valores de medición no permite concluir ningún diagnóstico seguro de la frecuencia cardíaca, sino que sirve exclusivamente para mostrar la variación óptica actual de la señal en el punto de medición.
- No utilice los resultados de medición para realizar ningún autodiagnóstico o autotratamiento sin consultar a su médico. Especialmente, no modifique por sí solo el tipo y/o la dosis de su medicación pautada actual ni empiece a tomar por sí solo ninguna medicación.

- El aparato solo puede mostrar un valor de medición momentáneo y no puede utilizarse para realizar una monitorización continua.

ⓘ **¡ATENCIÓN!**

- Utilice exclusivamente los accesorios incluidos en el volumen de suministro o recomendados por el fabricante.
- Proteja el aparato contra la humedad, el polvo, las altas temperaturas y la radiación solar directa.

- Si se almacena el aparato en un lugar con una temperatura próxima a los valores límite de temperatura de almacenamiento y transporte y se traslada a un entorno con una temperatura de 20 °C, espere unas 2 horas antes de ponerlo en funcionamiento para que se atempere.
- Queda prohibido abrir la carcasa del aparato, desmontarla o intentar repararla. En tal caso, no podrá garantizarse la seguridad del aparato y se anulará el derecho a la garantía.
- No deje caer el aparato ni lo someta a sacudidas fuertes.

- Como el aparato contiene componentes electrónicos sensibles, evite su uso directo en un entorno con un campo electromagnético fuerte (p. ej., cerca de teléfonos móviles, hornos microondas, etc.), ya que podría provocar resultados imprecisos.

5.1. Indicaciones de seguridad sobre la manipulación de las pilas

⚠ ¡ADVERTENCIA! El manejo incorrecto de las pilas puede provocar incendios, explosiones, fugas de sustancias peligrosas y otras situaciones de peligro.

-   Mantenga las pilas siempre fuera del alcance de los niños.
- Asegúrese de que nadie ingiera una pila.
- Si usted u otra persona ha ingerido una pila, busque inmediatamente asistencia médica.
- Utilice exclusivamente el tipo de pila indicado.
-  No recargue nunca las pilas no recargables.
- Retire las pilas recargables del aparato antes de cargarlas.
-   No tire nunca las pilas al fuego o al agua.

- No exponga las pilas a temperaturas elevadas ni a la radiación solar directa.
-   No abra o deforme nunca las pilas.
-  No cortocircuite los contactos.
- Retire las pilas gastadas del aparato y deséchelas de forma segura.
-   No utilice tipos distintos de pilas ni pilas nuevas y gastadas a la vez.
-   Introduzca siempre las pilas con la polaridad correcta en el aparato.

- Extraiga las pilas cuando no vaya a utilizar el aparato durante un periodo prolongado.
- Revise las pilas de forma periódica. Las fugas en las pilas pueden provocar lesiones y dañar el aparato.
- ¡Utilice guantes de protección si las pilas tienen fugas! Limpie los contactos de la pila y del aparato, así como el compartimento para pilas, con un paño seco. Evite el contacto de la piel y las mucosas, especialmente de los ojos, con los productos químicos. En caso de contacto, elimine los productos químicos aclarando la zona afectada con agua abundante y busque inmediatamente asistencia médica.

6. Descripción del aparato

(Consulte las ilustraciones de la página desplegable)

Figura A:

- ❶ Pantalla
- ❷ Botón de encendido/funciones 
- ❸ Orificio para el dedo
- ❹ Tapa del compartimento para pilas (en la parte posterior)
- ❺ Orificio para la cinta de sujeción

Figura B:

- ❻ Indicador de carga de las pilas 
- ❼ Frecuencia cardíaca (pulsaciones por minuto) PR bpm
- ❽ Columna del pulso

- 9 Onda del pulso (onda pletismográfica)
- 10 Índice de perfusión **PI** %
- 11 Saturación de oxígeno de la hemoglobina en sangre arterial %**SpO₂**

Figura C:

- 12 Pilas

Figura D:

- 13 Cinta de sujeción

7. Puesta en funcionamiento

- 1) Extraiga todas las piezas del aparato y las instrucciones de uso del embalaje.
- 2) Retire todo el material de embalaje, así como las posibles láminas y adhesivos.

7.1. Inserción/cambio de las pilas

Indicación

- ▶ Inserte siempre exclusivamente 2 pilas alcalinas de tipo AAA (LR03) en el compartimento para pilas.
- 1) Desplace la tapa del compartimento para pilas  hacia fuera.
- 2) Si procede, extraiga las pilas usadas.
- 3) Inserte 2 pilas nuevas según la polaridad indicada en el compartimento para pilas.
- 4) Vuelva a colocar la tapa del compartimento para pilas  hasta que encastre.

Indicación

- ▶ Si las pilas están a punto de agotarse, en la pantalla  aparece la indicación "LowPower" y el aparato se apaga. Cambie las pilas inmediatamente.

7.2. Colocación de la cinta de sujeción

- 1) Introduzca la parte fina de la cinta de sujeción 13 a través del orificio para la cinta de sujeción 5.
- 2) Introduzca la parte gruesa de la cinta de sujeción 13 a través del bucle formado (consulte la fig. D).

7.3. Realización de la medición

- 1) Introduzca un dedo en el orificio para el dedo 3.
- 2) Pulse el botón de encendido/funciones  2 varias veces hasta que aparezca la indicación B) mostrada en la página desplegable.
- 3) Espere un momento hasta que aparezcan los valores de medición en la pantalla 1.

Indicación

- Si no se ha introducido ningún dedo en el orificio para el dedo 3, aparece la indicación "Finger out" en la parte inferior de la pantalla 1 y el aparato se apaga.

- El aparato se apaga automáticamente si está inactivo durante un tiempo determinado.

7.4. Evaluación de los valores de medición

⚠ ¡ADVERTENCIA! Los valores explicados a continuación no se aplican a personas con enfermedades previas, como, p. ej., insuficiencia cardíaca o asma, ni para el uso del aparato a una altitud por encima de los 1500 m. Si padece alguna enfermedad previa, consulte siempre a un médico sobre sus valores.

Resultado de la medición de SpO ₂ en %	Clasificación/medidas que deben tomarse
99-94	Rango normal
93-90	Rango bajo: se recomienda consultar a un médico

Resultado de la medición de SpO ₂ en %	Clasificación/medidas que deben tomarse
<90	Rango crítico: ¡busque inmediatamente asistencia médica!
Fuente: basado en "Windisch W et al. S2k-Leitlinie: Nichtinvasive und invasive Beatmung als Therapie der chronischen respiratorischen Insuffizienz – Revision 2017; Pneumologie 2017; 71: 722-795"	

Caída de la saturación de oxígeno por la altitud

i Indicación

- En la siguiente tabla, encontrará los distintos efectos que las distintas altitudes provocan en el valor de la saturación de oxígeno y en el organismo humano. Los valores explicados a continuación tampoco se aplican a personas con enfermedades previas,

como, p. ej., insuficiencia cardíaca, asma y enfermedades de las vías respiratorias. Si se padece alguna enfermedad previa, los síntomas de enfermedad pueden aparecer incluso en zonas de poca altitud.

Altitud	Valor de SpO₂ previsible en %	Consecuencias para las personas
1500-2500 m	> 90	Sin mal de altura (generalmente)
2500-3000 m	~ 90	Mal de altura, se recomienda adaptación
Fuente: Hackett PH, Roach RC: High-Altitude Medicine. En: Auerbach PS (ed): Wilderness Medicine, 3rd edition; Mosby, St. Louis, MO 1995; 1-37.		

7.5. Realización de ajustes

- Con el aparato encendido, vuelva a pulsar el botón de encendido/funciones  ② para cambiar entre las distintas indicaciones en la pantalla.
- Con el aparato encendido, mantenga pulsado el botón de encendido/funciones  ② para abrir el menú de ajustes. Vuelva a pulsar el botón de encendido/funciones  ② para cambiar entre los distintos puntos del menú. Mantenga pulsado el botón de encendido/funciones  ② para modificar el punto del menú marcado con "*":
 - "Alm": si esta función está ajustada en "on", se emite un sonido con las mediciones.
 - "Pulse Beep": si esta función está ajustada en "on", se emite una alarma al alcanzar la frecuencia cardíaca ajustada.
 - "SpO₂ lo": aquí puede ajustarse un valor mínimo de saturación de oxígeno para el que deba sonar una alarma.
 - "PR Hi": aquí puede ajustarse un valor máximo de frecuencia cardíaca para el que deba sonar una alarma.

- "PR Lo": aquí puede ajustarse un valor mínimo de frecuencia cardíaca para el que deba sonar una alarma.
- "Restore": aquí pueden restablecerse los ajustes de fábrica.
- "+/-": aquí puede ajustarse el aumento o la disminución de los valores de ajuste.
- "Exit": esta opción permite salir del menú de ajuste y volver al modo de medición.

8. Limpieza

¡PELIGRO!

- ▶ ¡No sumerja nunca el aparato en agua ni en otros líquidos!

¡ATENCIÓN!

- ▶ No utilice productos de limpieza ni disolventes abrasivos ni corrosivos, ya que pueden dañar la superficie y provocar daños irreparables en el aparato.
- En caso necesario, limpie el aparato con un paño húmedo.

9. Almacenamiento

- Si no pretende utilizar el aparato durante un periodo prolongado de tiempo, extraiga las pilas.
- Guarde el aparato en un lugar seco y sin polvo. Observe las condiciones de almacenamiento y transporte (consulte la sección **11. Características técnicas**).

10. Desecho



El símbolo de un contenedor tachado significa que este aparato no debe desecharse con la basura doméstica al final de su vida útil, sino en puntos de recogida, puntos limpios o empresas de desechos previstas especialmente para ello.

Antes de entregar el aparato, le rogamos que elimine todos los datos personales.

Antes de entregar el aparato, retire las pilas o baterías que no estén encerradas en el aparato usado, así como las luces que puedan extraerse sin romperse, y recíclelas por separado.

Si la batería está integrada en el aparato de forma fija, debe indicarse que el aparato contiene una batería para su desecho.

El embalaje consta de materiales ecológicos que pueden desecharse a través de los centros de reciclaje locales.

Deseche el embalaje de forma respetuosa con el medio ambiente.

10.1. Desecho de las pilas/baterías



Las pilas/baterías son residuos especiales que deben desecharse de forma ecológica a través de las entidades correspondientes (comercios, distribuidores especializados, instalaciones públicas municipales o empresas de desechos industriales). Las pilas/baterías pueden contener metales pesados tóxicos.

Dichos metales pesados aparecen marcados con letras bajo el símbolo correspondiente: Cd = cadmio, Hg = mercurio, Pb = plomo.

Por lo tanto, las pilas/baterías no deben desecharse con la basura doméstica, sino reciclarse por separado.

Devuelva las pilas o baterías exclusivamente en estado descargado.

11. Características técnicas

Nombre del dispositivo, modelo	SPO 3 A1
Método de medición	Medición no invasiva de la saturación de oxígeno de la hemoglobina en sangre arterial y de la frecuencia cardíaca en el dedo
Rango de medición	SpO ₂ : 35~100% Frecuencia cardíaca: 30~250 pulsaciones/min

Precisión	SpO ₂ : 80 %~100 %: ± 2 %; Frecuencia cardíaca: 30-250 ± 2 pulsaciones/min
Desviación máx. de la medición de la indicación de la frecuencia cardíaca	SpO ₂ : 1 % Frecuencia cardíaca: 1 pulsación/min
Condiciones de funcionamiento	Temperatura ambiente: de +10 °C a +40 °C Humedad relativa: ≤ 75 % (sin condensación) Presión atmosférica: 700-1060 hPa
Condiciones de transporte/almacenamiento	Temperatura ambiente: de -40 °C a +60 °C Humedad relativa: ≤ 95 % (sin condensación) Presión atmosférica: 500-1060 hPa
Alimentación de corriente	2 pilas de 1,5 V  AAA (LR03)

Vida útil de la batería	2 pilas AAA ofrecen aprox. 2 años de funcionamiento si se realizan 3 mediciones al día (de 60 segundos cada una).
Dimensiones (L x An x Al)	63,7 × 35 × 35 mm
Peso	Aprox. 60 g (con pilas incluidas)
Clasificación	IP22

Indicaciones sobre la compatibilidad electromagnética

- Este aparato es apto para su uso en todos los entornos especificados en estas instrucciones de uso, incluido el entorno doméstico.

¡ADVERTENCIA!

- Este aparato cumple con la norma EN 60601-1-2 y se somete a medidas de precaución especiales en lo referente a la compatibilidad electromagnética.

Le rogamos que tenga en cuenta que los equipos de comunicaciones portátiles y móviles de AF (incluidos los dispositivos periféricos, como cables de antena y antenas externas) pueden influir sobre el funcionamiento de este aparato.

Al utilizar este aparato, evite las interferencias electromagnéticas fuertes, como, p. ej., las generadas en las inmediaciones de teléfonos móviles, microondas, etc. Mantenga el pulsioxímetro a una distancia mínima de 30 cm con respecto a dichos aparatos.

- Debe evitarse el uso de este aparato directamente al lado de otros aparatos o apilado con otros aparatos, ya que podría provocar errores de funcionamiento. Si tal uso es necesario, el aparato y los otros dispositivos deben supervisarse para garantizar que funcionan correctamente.
- El uso de accesorios, transformadores y cables no especificados ni suministrados por el fabricante puede provocar emisiones electromagnéticas elevadas o reducir la inmunidad electromagnética del aparato y causar errores de funcionamiento.
- El incumplimiento de estas medidas puede afectar al funcionamiento del aparato.

- Este aparato no puede utilizarse en un entorno de RM.
- Es posible que, bajo determinadas circunstancias, el uso de este aparato solo sea limitado en presencia de interferencias electromagnéticas. En consecuencia, pueden aparecer, p. ej., mensajes de error o producirse un fallo de la pantalla/aparato.

Directivas y normas

- Este aparato cumple con las siguientes normas, leyes y reglamentos:
 - Reglamento UE sobre los productos sanitarios MDR (UE) 2017/745
 - **Directiva sobre las restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos (2011/65/EU)***
- * La responsabilidad exclusiva de la expedición de esta declaración de conformidad recaerá sobre el fabricante. El objeto descrito en la declaración cumple con las disposiciones de la Directiva 2011/65/EU del Parlamento Europeo y del Consejo del 8 de junio de 2011 sobre las restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos.

- EN 60601-1
- EN 60601-1-2
- EN 60601-1-11
- DIN EN ISO 80601-2-61
- IEC 62471
- EN 60601-1-6
- EN 62366-1
- EN 62304

Notificación de incidentes no deseados para usuarios/pacientes en países de la UE

Si un usuario/paciente cree que ha sido víctima de un incidente grave en relación con el producto, se solicita a dicho usuario/paciente que notifique el incidente al fabricante y/o a su representante autorizado, así como a las autoridades competentes del Estado miembro en el que se encuentre dicho usuario/paciente.

12. Garantía de Kompernass Handels GmbH

Estimado cliente:

Este aparato cuenta con una garantía de 3 años a partir de la fecha de compra. Si se detectan defectos en el producto, puede ejercer sus derechos legales frente al vendedor. Estos derechos legales no se ven limitados por la garantía descrita a continuación.

Condiciones de la garantía

El plazo de la garantía comienza con la fecha de compra. Guarde bien el comprobante de caja, ya que lo necesitará como justificante de compra.

Si dentro de un periodo de tres años a partir de la fecha de compra de este producto se detecta un defecto en su material o un error de fabricación, asumiremos la reparación o sustitución gratuita del producto o restituiremos el precio de compra a nuestra elección. La prestación de la garantía requiere la presentación del aparato defectuoso y del justificante de compra (comprobante de caja), así como una breve descripción por escrito del defecto detectado y de las circunstancias en las que se haya producido dicho defecto, dentro del plazo de tres años.

Si el defecto está cubierto por nuestra garantía, le devolveremos el producto reparado o le suministraremos uno nuevo. La reparación o sustitución del producto no supone el inicio de un nuevo periodo de garantía.

Duración de la garantía y reclamaciones legales por vicios

La duración de la garantía no se prolonga por hacer uso de ella. Este principio también se aplica a las piezas sustituidas y reparadas. Si después de la compra del aparato, se detecta la existencia de daños o de defectos al desembalarlo, deben notificarse de inmediato. Cualquier reparación que se realice una vez finalizado el plazo de garantía estará sujeta a costes.

Alcance de la garantía

El aparato se ha fabricado cuidadosamente según estándares elevados de calidad y se ha examinado en profundidad antes de su entrega.

La prestación de la garantía se aplica a defectos en los materiales o errores de fabricación. Esta garantía no cubre las piezas del producto normalmente sometidas al desgaste y que, en consecuencia, puedan considerarse piezas de desgaste ni los daños producidos en los componentes frágiles, p. ej., interruptores o piezas de vidrio.

Se anulará la garantía si el producto se daña o no se utiliza o mantiene correctamente. Para utilizar correctamente el producto, deben observarse todas las indicaciones especificadas en las instrucciones de uso. Debe evitarse cualquier uso y manejo que esté desaconsejado o frente al que se advierta en las instrucciones de uso.

El producto está previsto exclusivamente para su uso privado y no para su uso comercial. En caso de manipulación indebida e incorrecta, uso de la fuerza y apertura del aparato por personas ajenas a nuestros centros de asistencia técnica autorizados, la garantía perderá su validez.

Proceso de reclamación conforme a la garantía

Para garantizar una tramitación rápida de su reclamación, le rogamos que observe las siguientes indicaciones:

- Mantenga siempre a mano el comprobante de caja y el número de artículo (IAN) 518645_2504 como justificante de compra.
- Podrá ver el número de artículo en la placa de características del producto, grabado en el producto, en la portada de las instrucciones de uso (parte inferior izquierda) o en el adhesivo de la parte trasera o inferior del producto.
- Si se producen errores de funcionamiento u otros defectos, póngase primero en contacto con el departamento de asistencia técnica especificado a continuación **por teléfono o por correo electrónico.**
- Podrá enviar el producto calificado como defectuoso junto con el justificante de compra (comprobante de caja) y la descripción del defecto y de las circunstancias en las que se haya producido de forma gratuita a la dirección de correo proporcionada.



En www.lidl-service.com, podrá descargar este manual de usuario y muchos otros más, así como vídeos sobre los productos y software de instalación.

Con este código QR, accederá directamente a la página del Servicio Lidl (www.lidl-service.com) y podrá abrir las instrucciones de uso mediante la introducción del número de artículo (IAN) 518645_2504.

12.1. Asistencia técnica

ES

Servicio España

Tel.: 900 984 989

E-Mail: kompernass@lidl.es

IAN 518645_2504

12.2. Importador

Tenga en cuenta que la dirección siguiente no es una dirección de asistencia técnica. Póngase primero en contacto con el centro de asistencia técnica especificado.

Para el mercado de la UE



KOMPERNASS HANDELS GMBH
BURGSTRASSE 21
44867 BOCHUM
GERMANY

www.kompernass.com

Para el mercado de GB

Lidl Great Britain Ltd
Lidl House 14 Kingston Road
Surbiton
KT5 9NU

Índice

1. Introdução	295
2. Utilização correta	295
2.1. Contraindicações	296
3. Conteúdo da embalagem	297
4. Indicações de aviso e símbolos utilizados	297
5. Instruções de segurança	305
5.1. Instruções de segurança relativas ao manuseamento de pilhas.....	313
6. Descrição do aparelho	317
7. Colocação em funcionamento	319
7.1. Colocar/substituir as pilhas	319
7.2. Instalar a fita de transporte.....	320

7.3. Efetuar a medição.	320
7.4. Avaliação dos valores medidos	321
7.5. Configurar as definições.	324
8. Limpeza	325
9. Armazenamento	326
10. Eliminação	326
10.1. Eliminação das pilhas	327
11. Dados técnicos	328
12. Garantia da Kompernass Handels GmbH	334
12.1. Assistência Técnica	338
12.2. Importador	339

1. Introdução

Parabéns pela compra do seu novo aparelho.

Optou por um produto de elevada qualidade. O manual de instruções é parte integrante deste produto. Contém instruções importantes sobre a segurança, a utilização e a eliminação. Antes de utilizar o produto, familiarize-se com todas as instruções de operação e segurança. Utilize o produto apenas como descrito e nas áreas de aplicação indicadas. Guarde sempre o manual de instruções na proximidade do produto para futuras consultas. Ao transferir o produto para terceiros, entregue todos os respetivos documentos.

2. Utilização correta

Este aparelho destina-se à medição não invasiva da saturação arterial de oxigénio da hemoglobina e da frequência cardíaca, através do dedo de adultos. A saturação de oxigénio é um indicador importante para a avaliação da função respiratória.

Uma baixa saturação de oxigénio pode indicar uma doença, como asma ou insuficiência cardíaca. Nesse caso, consulte imediatamente um médico!

O aparelho não é adequado para utilização em recém-nascidos ou crianças pequenas, nem em pessoas com arritmias cardíacas graves.

O aparelho é apropriado para automedicação. Não são necessários conhecimentos técnicos específicos; o paciente pode operar o aparelho ele mesmo.

Este aparelho foi concebido exclusivamente para uso doméstico. Não utilize este aparelho para fins comerciais ou industriais.

2.1. Contraindicações

Durante a gravidez, recomenda-se a consulta de um médico antes da utilização do aparelho. Pacientes com pré-eclâmpsia não devem utilizar o aparelho.

O aparelho não é adequado para pacientes com dispositivos elétricos implantados, como pacemakers ou desfibrilhadores. Não utilize o aparelho se tiver implantes metálicos.

3. Conteúdo da embalagem

A embalagem inclui os seguintes componentes:

- Pulsoxímetro
- 2 pilhas alcalinas de tipo micro AAA (LR03)
- Fita de transporte
- Manual de instruções

4. Indicações de aviso e símbolos utilizados

No presente manual de instruções, na embalagem e no aparelho são utilizadas as seguintes indicações de aviso e símbolos (se aplicável):



PERIGO! Uma indicação de aviso com este símbolo e com a palavra-sinal "PERIGO" identifica uma situação de perigo iminente que, se não for evitada, terá como consequência ferimentos graves ou mortais.

	AVISO! Uma indicação de aviso com este símbolo e com a palavra-sinal "AVISO" identifica uma possível situação de perigo que, se não for evitada, poderá ter como consequência ferimentos graves ou mortais.
	CUIDADO! Uma indicação de aviso com este símbolo e com a palavra-sinal "CUIDADO" identifica uma possível situação de perigo que, se não for evitada, poderá ter como consequência ferimentos ligeiros ou moderados.
	ATENÇÃO! Uma indicação de aviso com este símbolo e com a palavra-sinal "ATENÇÃO" identifica uma possível situação que, se não for evitada, poderá ter como consequência danos materiais.
	Nota: uma nota fornece informações adicionais que facilitam o manuseamento do aparelho.

	Ter em atenção o manual de instruções! Ler o manual de instruções antes de iniciar qualquer trabalho e/ou utilizar aparelhos ou máquinas.
	Tensão/corrente contínua
	Produto médico
	Importador
	Tipo BF: o aparelho foi concebido de forma a proteger o paciente contra choques elétricos.
IP22	Protegido contra corpos estranhos $\geq 12,5$ mm e contra água a pingar obliquamente

%SpO₂	Saturação arterial de oxigénio da hemoglobina (em percentagem)
PR bpm	Frequência cardíaca (batimentos por minuto)
PI %	O Índice de Perfusão (PI) é a relação entre o fluxo sanguíneo pulsátil e o fluxo não pulsátil no tecido periférico do paciente.
	Indicador do estado das pilhas
	Ano/mês de fabrico
	Unique Device Identifier: código para identificação única do produto
	Número de série
	Número do artigo

	Número do modelo
	Intervalo de temperatura
	Intervalo de humidade relativa
	Intervalo de pressão atmosférica
	Não eliminar o aparelho elétrico no lixo doméstico!

	Elimine a embalagem de modo ecológico.
	Válido até
	Embalagem composta por materiais recicláveis. Tenha em atenção a identificação dos materiais de embalagem ao proceder à separação de resíduos: Estes estão identificados com abreviaturas (a) e algarismos (b), com os seguintes significados: 1-7: plásticos, 20-22: papel e cartão, 80-98: compostos.



A embalagem contém componentes de papel e/ou cartão.



A embalagem contém componentes de plástico e/ou metal.

ES/PT



Este produto cumpre os requisitos das diretivas europeias e nacionais em vigor.



Este símbolo confirma que o produto cumpre os requisitos de segurança do produto em vigor na Grã-Bretanha.



Endereço do fabricante: Shenzhen BSX Technology Electronics Co., Ltd.
Rm101,2/F~4/F, Building no.13, Ailian Industrial Park, Wulian Community, Longgang District, Shenzhen 518116 Guangdong, P.R. China



Representante autorizado na Comunidade Europeia/União Europeia:
MedNet EC-REP GmbH
Borkstrasse 10, 48163 Münster, Alemanha



FR
Cet appareil,
ses accessoires
et piles
se recyclent

À DÉPOSER
EN MAGASIN

ou

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE

Points de collecte sur www.quefairedelesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



FR: O produto, a embalagem e o manual de instruções são recicláveis, estão abrangidos pelo regime de responsabilidade alargada do fabricante e sujeitos a recolha separada.

5. Instruções de segurança

AVISO!

- Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais limitadas, ou com falta de experiência e/ou de conhecimento, salvo se forem vigiadas por uma pessoa responsável pela sua segurança ou que desta recebam instruções acerca do funcionamento do aparelho.
- As crianças têm de ser vigiadas para garantir que não brincam com o aparelho.

- Não utilize o aparelho se tiver implantes elétricos (por exemplo, pacemaker).
- Não utilize o aparelho se tiver implantes metálicos.
- Não utilize o aparelho em recém-nascidos, crianças ou animais de estimação.
- Não utilize o aparelho se for alérgico a produtos de borracha.
- Não utilize o aparelho se o mesmo ou o dedo onde vai ser aplicado estiverem húmidos.

- Não utilize o aparelho durante uma medição da tensão arterial no braço onde está colocada a braçadeira.
- Não utilize o aparelho em dedos com unhas pintadas com verniz, com sujidade ou com pensos rápidos.
- Não utilize o aparelho em dedos com diâmetro demasiado grande que não possam ser inseridos confortavelmente no aparelho. Não utilize também em dedos demasiado pequenos.
- Não utilize o aparelho em dedos com alterações anatómicas, edemas, cicatrizes, verniz, unhas artificiais, outros cosméticos ou queimaduras.

- Não utilize o aparelho em pacientes que estejam inquietos no local de aplicação (por exemplo, tremores).
- Não utilize o aparelho durante mais de aprox. 2 horas no mesmo dedo.
- Não olhe para o interior do aparelho enquanto este estiver em funcionamento. A luz pode causar danos oculares.
- Não utilize o aparelho perto de fontes de luz intensas.
- Os valores medidos por si próprio destinam-se apenas a um autocontrolo – não substituem uma consulta médica! Fale sempre com o seu médico sobre os resultados.

Nunca tome decisões médicas por iniciativa própria (como a toma ou ajuste de medicação) com base nesses valores!

- Doenças cardiovasculares podem originar medições incorretas ou afetar a precisão da medição. O mesmo se aplica a tensão arterial muito baixa, diabetes, distúrbios da circulação e do ritmo cardíaco, bem como a situações de tremores ou calafrios.
- A indicação dos valores medidos não permite um diagnóstico fiável da pulsação, servindo exclusivamente para representar a variação ótica atual do sinal no local de medição.

- Não realize qualquer autodiagnóstico ou autotratamento com base nos resultados das medições sem consultar previamente o seu médico assistente. Em especial, não altere por iniciativa própria o tipo e/ou a dosagem de qualquer medicação existente, nem inicie qualquer medicação por conta própria.
- O aparelho apenas indica um valor momentâneo da medição e não pode ser utilizado para monitorização contínua.

⚠ **ATENÇÃO!**

- Utilize apenas os acessórios fornecidos com o produto ou recomendados pelo fabricante.
- Proteja o aparelho da humidade, do pó, de temperaturas elevadas e da exposição direta à luz solar.
- Se o aparelho tiver sido armazenado a uma temperatura próxima dos limites indicados para armazenamento e transporte e for colocado num ambiente a 20 °C, aguarde cerca de 2 horas antes de o utilizar, para que o aparelho atinja a temperatura ambiente.

- Não deve abrir, desmontar ou reparar o corpo do aparelho. A segurança do aparelho ficará comprometida e a garantia será anulada.
- Não deixe cair o aparelho nem o sujeite a impactos fortes.
- Como o aparelho contém componentes eletrónicos sensíveis, evite utilizá-lo diretamente em ambientes com forte interferência eletromagnética (por exemplo, junto a um telemóvel, micro-ondas, etc.), pois isso pode originar resultados imprecisos.

5.1. Instruções de segurança relativas ao manuseamento de pilhas

⚠ AVISO! Um manuseamento incorreto das pilhas pode levar à ocorrência de incêndios, explosões, derramamento de substâncias perigosas ou outras situações de perigo!

-  Mantenha as pilhas impreterivelmente fora do alcance das crianças.
- Certifique-se de que ninguém ingere uma pilha.
- Em caso de ingestão de uma pilha, procure imediatamente assistência médica.

- Utilize apenas o tipo de pilha indicado.
-  Nunca recarregue pilhas não recarregáveis.
- Remova as pilhas recarregáveis do aparelho antes de as recarregar.
-   Nunca deite pilhas para o fogo ou para dentro de água.
- Não exponha as pilhas a temperaturas elevadas, nem a radiação solar direta.
-   Nunca abra nem deforme as pilhas.

-  Não ligue os terminais em curto-circuito.
- Retire as pilhas descarregadas do aparelho e elimine-as de forma segura.
-   Não utilize tipos de pilhas diferentes, nem pilhas novas em conjunto com pilhas usadas.
-   Coloque as pilhas no aparelho, respeitando sempre a polaridade correta.
- Caso não pretenda utilizar o aparelho por um período de tempo prolongado, retire as pilhas.

- Verifique regularmente as pilhas. Pilhas com fuga de líquido podem provocar ferimentos e danificar o aparelho.
- Em caso de derrame das pilhas, utilize luvas de proteção ao manusear as mesmas! Limpe o compartimento das pilhas e os contactos das pilhas e do aparelho com um pano seco. Evite o contacto da pele e das mucosas, em particular os olhos, com as substâncias químicas. Em caso de contacto com as substâncias químicas, lave com água abundante e procure imediatamente assistência médica.

6. Descrição do aparelho

(Figuras, ver página desdobrável)

Figura A:

- 1 Visor
- 2 Tecla de ligar/função 
- 3 Abertura para o dedo
- 4 Tampa do compartimento das pilhas (na parte traseira)
- 5 Argola para fita de transporte

Figura B:

- 6 Indicador do estado das pilhas 
- 7 Frequência cardíaca (batimentos por minuto) PR bpm
- 8 Barra de pulsação
- 9 Onda de pulsação (onda pletismográfica)
- 10 Índice de perfusão **PI** %
- 11 Saturação arterial de oxigénio da hemoglobina **%SpO₂**

Figura C:

- 12 Pilhas

Figura D:

- 13 Fita de transporte

7. Colocação em funcionamento

- 1) Retire todas as peças do aparelho e o manual de instruções da embalagem.
- 2) Remova todos os materiais de embalagem e eventuais películas e autocolantes.

7.1. Colocar/substituir as pilhas

i Nota

- Coloque sempre apenas 2 pilhas alcalinas do tipo AAA (LR03) no compartimento das pilhas.
- 1) Deslize a tampa do compartimento das pilhas **4** para fora.
 - 2) Se contiver pilhas usadas, retire-as.
 - 3) Coloque 2 pilhas novas de acordo com a polaridade indicada no compartimento das pilhas.
 - 4) Recoloque a tampa do compartimento das pilhas **4**, de forma a que fique encaixada.

Nota

- ▶ Quando as pilhas estiverem quase descarregadas, no visor **1** surgirá a indicação "LowPower" e o aparelho desligar-se-á. Substitua imediatamente as pilhas.

7.2. Instalar a fita de transporte

- 1) Passe a parte fina da fita de transporte **13** pela argola para fita de transporte **5**.
- 2) Passe a parte mais grossa da fita de transporte **13** pela alça da fita de transporte (ver fig. D).

7.3. Efetuar a medição

- 1) Introduza um dedo na abertura para o dedo **3**.
- 2) Prima a tecla de ligar/função  **2**, várias vezes, até aparecer a indicação da figura B) na página desdobrável.
- 3) Aguarde um momento, até os valores da medição aparecerem no visor **1**.

Nota

- ▶ Se nenhum dedo estiver inserido na abertura para o dedo ❸, surge a mensagem "Finger out" na parte inferior do visor ❶ e o aparelho desliga-se.
- ▶ O aparelho desliga-se automaticamente após um determinado período de inatividade.

7.4. Avaliação dos valores medidos

 **AVISO!** Os valores indicados a seguir não são válidos para pessoas com doenças pré-existentes, como insuficiência cardíaca, asma, ou para permanência em altitudes superiores a 1500 m. Caso sofra de alguma doença pré-existente, consulte sempre o seu médico para interpretar os resultados.

Resultado da medição SpO₂ em %	Classificação/medidas a tomar
99-94	Intervalo normal

Resultado da medição SpO₂ em %	Classificação/medidas a tomar
93-90	Intervalo reduzido: Recomenda-se uma consulta médica
<90	Intervalo crítico: Procure um médico com urgência!
Fonte: adaptado de "Windisch W et al. Diretriz S2k: Ventilação não invasiva e invasiva como terapia da insuficiência respiratória crónica - Revisão 2017; Pneumologia 2017; 71: 722-795"	

Queda da saturação de oxigénio em função da altitude

i Nota

- ▶ A tabela seguinte mostra os diferentes efeitos das várias altitudes sobre o valor de saturação de oxigénio e o organismo humano. Os valores apresentados em seguida

não se aplicam a pessoas com doenças pré-existentes, como insuficiência cardíaca, asma ou outras doenças respiratórias. Nestes casos, os sintomas clínicos podem surgir já a altitudes mais baixas.

Altitude	Valor de SpO₂ expectável em %	Efeitos no organismo humano
1500-2500 m	> 90	Sem doença da altitude (geralmente)
2500-3000 m	~ 90	Doença da altitude, recomendada aclimação
Fonte: Hackett PH, Roach RC: High-Altitude Medicine. In: Auerbach PS (ed): Wilderness Medicine, 3.ª edição; Mosby, St. Louis, MO 1995; 1-37.		

7.5. Configurar as definições

- Prima novamente a tecla de ligar/função  2 com o aparelho ligado, para alternar entre as diferentes indicações no visor.
- Com o aparelho ligado, mantenha premida a tecla de ligar/função  2, para aceder ao menu de definições. Prima novamente a tecla de ligar/função  2, para percorrer os diferentes itens do menu. Mantenha premida a tecla de ligar/função  2 para modificar o item do menu assinalado com um asterisco "*":
 - "Alm": quando esta função está ativa ("on"), é emitido um som durante as medições.
 - "Pulse Beep": quando esta função está ativa ("on"), é emitido um alarme ao ser atingida a frequência cardíaca definida.
 - "SpO₂ lo": permite definir um valor mínimo de saturação de oxigénio a partir do qual o alarme é acionado.
 - "PR Hi": permite definir um valor máximo de frequência cardíaca (batimentos por minuto), a partir do qual o alarme é acionado.

- "PR Lo": permite definir um valor mínimo de frequência cardíaca, a partir do qual o alarme é acionado.
- "Restore": permite repor as definições de fábrica.
- "+/-": permite selecionar se os valores de definição devem ser aumentados ou diminuídos.
- "Exit": permite sair do menu de definições e voltar ao modo de medição.

8. Limpeza



PERIGO!

- ▶ Nunca mergulhe o aparelho em água ou noutros líquidos!



ATENÇÃO!

- ▶ Não utilize detergentes abrasivos ou corrosivos, nem solventes. Estes podem danificar a superfície e causar danos irreparáveis no aparelho.
- Se necessário, limpe o aparelho com um pano húmido.

9. Armazenamento

- Se o aparelho não for utilizado durante um longo período de tempo, retire as pilhas.
- Guarde o aparelho num local seco e sem pó. Tenha em atenção as condições de armazenamento e transporte (ver **11. Dados técnicos**).

10. Eliminação



O símbolo do contentor do lixo com uma cruz por cima indica que este aparelho, no final da sua vida útil, não deve ser eliminado juntamente com os resíduos domésticos. O aparelho deve ser entregue em pontos de recolha apropriados, ecocentros ou centros de tratamento de resíduos autorizados.

Por favor, elimine todos os dados pessoais do aparelho antes de o devolver.

Antes da devolução, remova as pilhas ou acumuladores que não estejam integrados no aparelho antigo, bem como as lâmpadas que possam ser retiradas sem danificar o equipamento, e entregue estes componentes numa recolha separada.

Se o acumulador estiver montado de forma fixa no aparelho, é importante informar a entidade responsável pela eliminação que o aparelho contém um acumulador.

A embalagem é composta por materiais amigos do ambiente e pode ser descartada nos pontos de reciclagem locais.

Elimine a embalagem de modo ecológico.

10.1. Eliminação das pilhas



As pilhas/acumuladores devem ser tratados como resíduos perigosos e, por conseguinte, eliminados de forma ecológica nos locais adequados (revendedores, revendedores especializados, entidades públicas municipais, empresas de eliminação de resíduos). As pilhas/os acumuladores podem conter metais pesados tóxicos.

Os metais pesados inclusos são identificados por letras sob o símbolo: Cd = cádmio, Hg = mercúrio, Pb = chumbo.

Por este motivo, nunca elimine pilhas/acumuladores no lixo doméstico comum, mas deposite-os num centro de recolha seletiva.

Entregue as pilhas/os acumuladores apenas quando estiverem completamente descarregados.

11. Dados técnicos

Nome do aparelho, modelo	SPO 3 A1
Método de medição	medição não invasiva da saturação arterial de oxigénio da hemoglobina e da frequência cardíaca no dedo
Intervalo de medição	SpO ₂ : 35~100% Pulsação 30~250 batimentos/min.

Precisão	SpO ₂ : 80%~100%: $\pm 2\%$; Pulsção 30-250 ± 2 batimentos/min.
Desvio máximo da indicação da pulsção	SpO ₂ : 1% Frequência cardíaca 1 batimento/min.
Condições de funcionamento	Temperatura ambiente de +10 °C a +40 °C Humidade relativa $\leq 75\%$ (sem condensação) Pressão atmosférica 700-1060 hPA
Condições de transporte/armazenamento	Temperatura ambiente de -40 °C a +60 °C Humidade relativa $\leq 95\%$ (sem condensação) Pressão atmosférica 500-1060 hPA
Alimentação de tensão	2 pilhas AAA de 1,5 V  (LR03)

Vida útil das pilhas	2 pilhas AAA permitem cerca de 2 anos de funcionamento com 3 medições por dia (cada uma com cerca de 60 segundos).
Dimensões (C x L x A)	63,7 x 35 x 35 mm
Peso	aprox. 60 g (incl. pilhas)
Classificação	IP22

Informações sobre compatibilidade eletromagnética

- O aparelho está preparado para funcionar em todos os ambientes indicados neste manual de instruções, incluindo ambientes domésticos.

AVISO!

- Este aparelho está em conformidade com a norma EN 60601-1-2 e requer precauções especiais no que diz respeito à compatibilidade eletromagnética.

Tenha em atenção que equipamentos de comunicação de radiofrequência (RF) portáteis e móveis (incluindo periféricos como cabos de antena e antenas externas) podem afetar o desempenho deste aparelho. Evite interferências eletromagnéticas intensas durante a utilização, como por exemplo, perto de telemóveis, micro-ondas ou equipamentos semelhantes. Mantenha o aparelho a, pelo menos, 30 cm de distância desses dispositivos.

- A utilização deste aparelho muito próximo de outros dispositivos ou empilhado com outros dispositivos deve ser evitada, pois pode provocar um funcionamento incorreto. Se for necessária essa utilização, todos os dispositivos devem ser monitorizados para garantir o seu funcionamento adequado.
- A utilização de acessórios, transdutores e cabos não fornecidos ou recomendados pelo fabricante pode causar emissões eletromagnéticas superiores ao permitido ou reduzir a imunidade do aparelho a interferências, podendo resultar num funcionamento incorreto.

- O não cumprimento destas indicações pode comprometer o desempenho do aparelho.
- Este aparelho não pode ser utilizado em ambientes com ressonância magnética (RM/MRI).
- O aparelho pode, na presença de interferências eletromagnéticas, funcionar apenas de forma limitada. Consequentemente, podem surgir mensagens de erro ou falhas no visor/aparelho.

Normas e diretrizes

- Este aparelho está em conformidade com as seguintes normas, leis e regulamentos:
 - Regulamento (EU) relativo aos dispositivos médicos MDR (EU) 2017/745
 - **Diretiva RSP** (2011/65/EU)*

* O fabricante é o único responsável pela emissão desta declaração de conformidade. O objeto da declaração acima descrito cumpre os regulamentos da Diretiva 2011/65/EU do Parlamento Europeu e do Conselho de 8 de junho de 2011, relativa à restrição do uso de determinadas substâncias perigosas em equipamentos elétricos e eletrónicos.

- EN 60601-1
- EN 60601-1-2
- EN 60601-1-11
- DIN EN ISO 80601-2-61
- IEC 62471
- EN 60601-1-6
- EN 62366-1
- EN 62304

Notificação de incidentes adversos por utilizadores/pacientes de países da União Europeia

Se os utilizadores ou pacientes considerarem que ocorreu um incidente grave relacionado com este produto, devem notificar esse incidente ao fabricante e/ou ao seu representante autorizado, bem como à autoridade competente do Estado-Membro onde o utilizador ou paciente se encontra.

12. Garantia da Kompernass Handels GmbH

Estimada Cliente, Estimado Cliente,

Este aparelho tem uma garantia de 3 anos a contar da data de compra. No caso deste produto ter defeitos, tem direitos legais contra o vendedor do produto. Estes direitos legais não são limitados pela nossa garantia que passamos a transcrever.

Condições de garantia

O prazo de garantia tem início na data da compra. Por favor, guarde bem o talão de compra. Este é necessário como comprovativo da compra.

Se, no prazo de três anos a contar da data de compra deste produto, ocorrer um defeito de material ou de fabrico, o produto será reparado ou substituído por nós, ao nosso critério, gratuitamente, ou o preço de compra será reembolsado. Esta garantia parte do princípio que o aparelho avariado e o comprovativo da compra (talão de compra) são apresentados no prazo de três anos, junto com uma descrição breve, por escrito, da falha e das circunstâncias em que a mesma ocorreu.

Se o defeito estiver coberto pela nossa garantia, receberá o produto reparado ou um novo produto. Com a substituição do produto é iniciado um novo prazo de garantia segundo DL 67/2003.

Prazo de garantia e direitos legais

O período de garantia não é prolongado pelo acionamento da mesma. Isto também se aplica a peças substituídas e reparadas. Danos e defeitos que possam eventualmente já existir no momento da compra devem ser imediatamente comunicados, após retirar o aparelho da embalagem. Expirado o período da garantia, quaisquer reparações necessárias estão sujeitas a pagamento.

Âmbito da garantia

O aparelho foi fabricado segundo diretivas de qualidade rigorosas, com o maior cuidado, e testado escrupulosamente antes da sua distribuição.

A garantia abrange apenas defeitos de material ou de fabrico. Esta garantia não abrange peças do produto sujeitas ao desgaste normal e que podem, por isso, ser consideradas peças de desgaste, ou danos em peças frágeis, p. ex., interruptores ou peças de vidro.

Esta garantia perde a validade, se o produto for danificado, utilizado incorretamente ou se a manutenção tenha sido realizada indevidamente. Para garantir uma utilização correta do produto, é necessário cumprir todas as instruções contidas no manual de instruções. Ações ou fins de utilização que são desaconselhados, ou para os quais é alertado no manual de instruções, têm de ser impreterivelmente evitados.

O produto foi concebido apenas para uso privado e não para uso comercial. A garantia extingue-se em caso de utilização incorreta, uso de força e intervenções que não tenham sido efetuadas pela nossa Filial de Assistência Técnica autorizada.

Procedimento em caso de acionamento da garantia

Para garantir um processamento rápido do seu pedido, siga, por favor, as seguintes instruções:

- Para todos os pedidos de esclarecimento, tenha à mão o talão de compra e o número do artigo (IAN) 518645_2504 como comprovativo da compra.
- O número do artigo consta da capa do manual de instruções (em baixo à esquerda), da placa de características, de uma impressão no produto ou do autocolante na traseira ou lado inferior do produto.
- Caso ocorram falhas de funcionamento ou outros defeitos, contacte primeiro o Serviço de Assistência Técnico, indicado em seguida, **telefonicamente** ou **por e-mail**.
- De seguida, pode enviar gratuitamente o produto registado como defeituoso, incluindo o comprovativo da compra (talão de compra) e indique o defeito e quando este ocorreu, para a morada do Serviço de Assistência Técnica que lhe foi indicada.



Em www.lidl-service.com poderá descarregar este manual de instruções e muitos outros manuais, bem como vídeos sobre produtos e software de instalação.

Com o código QR acede diretamente à página da Assistência Técnica Lidl (www.lidl-service.com) e poderá abrir o seu manual de instruções, introduzindo o número de artigo (IAN) 518645_2504.

12.1. Assistência Técnica

PT

Assistência Portugal Tel.: 800849000

E-Mail: kompernass@lidl.pt

IAN 518645_2504

12.2. Importador

Tenha presente que a seguinte morada não é a morada do Serviço de Assistência Técnica. Entre primeiro em contacto com o Serviço de Assistência Técnica mencionado.

Para o mercado da UE



KOMPERNASS HANDELS GMBH
BURGSTRASSE 21
44867 BOCHUM
GERMANY

www.kompernass.com

Para o mercado da GB

Lidl Great Britain Ltd
Lidl House 14 Kingston Road
Surbiton
KT5 9NU

CE 0123



KOMPERNASS HANDELS GMBH
BURGSTRASSE 21 • 44867 BOCHUM
GERMANY • www.kompernass.com

Last Information Update · Stand der Informationen · Version
des informations · Stand van de informatie · Versione delle
informazioni · Estado de las informaciones · Estado das
informações: 06/2025 · Ident.-No.: SPO3A1-062025-2



PDF ONLINE
www.lidl-service.com

IAN 518645_2504